

Health o meter[®]


Your Measure for Good Health™

UPPER ARM

Blood Pressure Monitor

with

ComfortRead™ Technology



Model 7631

IMPORTANT NOTES

Please read this entire manual carefully before using this device.

Healthometer®

Upper Arm Blood Pressure Monitor

with ComfortRead™ Technology

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY

Features:

- **Fully-Automatic**
- **One-Touch Operation**
- **Extra Large, Easy-To-Read Digital Display**
- **90 Automatic Memory Feature**
- **ComfortRead™ Technology Minimizes Cuff Pressure, Maximizes Comfort**
- **Convenient Storage Case**

In accordance with International Standards:

CE **ISO**
0366 9001

Table of Contents

Introduction	3-4
Product Component Identification	4
Comfort Read™ Measuring Technology	4
Standards of Quality	5
About Blood Pressure	5
Blood Pressure Standard	6
Blood Pressure Fluctuation	6
Display Explanations	7
Installing Batteries	7-8
HOW TO USE	8-11
• Helpful Tips	8
• Applying the Arm Cuff	9-10
• Taking a Measurement	10-11
• Recalling Memory	11-12
Troubleshooting	12
Precautionary Notes	12-13
Specifications	13
Warranty Information	14

Introduction

Congratulations on your purchase of the new Health o meter® Arm Blood Pressure Monitor Model 7631. This fully automatic device is both easy to use and ideally suited for daily measurements. The large display includes systolic, diastolic and pulse measurements, all clearly shown at the completion of each reading.

In addition, you can store up to 90 measurements using the monitor's built-in memory feature, ideal for users who want to monitor and track their blood pressure on a regular basis. The Health o meter® blood pressure monitor is portable, making it ideal for both home and travel usage.

Standards of Quality

This Blood Pressure Monitor conforms with the American National Standards Institute/American Association of Medical Instrumentation Standards for Non-Invasive Blood Pressure Monitors. In addition, the device complies with the European regulations and bears the CE mark "CE 0366". The quality of the device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC dated 14 June 1993 concerning medical devices, as well as the EMC directive 89/336/EEC:

ANSI/AAMI SP10	Electronic or automated Sphygmomanometers
EN 1060-1 (Dec. 1995)	Non-invasive blood pressure measuring equipment General requirements
EN 1060-3 (Feb. 1997)	Non-invasive blood pressure measuring equipment Supplementary requirements for electromechanical blood pressure measuring systems

ABOUT BLOOD PRESSURE

What is Blood Pressure?


Blood pressure is the pressure exerted on the inside of the artery wall while blood flows through the artery. The pressure measured when the heart contracts and sends blood out of the heart is the "systolic" reading (higher number). The pressure measured when the heart dilates with blood flowing into the heart is called the "diastolic" (lowest number) blood pressure.

Why Measure Your Blood Pressure?

Various health problems associated to high blood pressure are quite common with people in today's society. There is a significant correlation of high blood pressure with cardiovascular disease. This correlation has made measuring one's blood pressure a necessity for those individuals identified with high blood pressure, placing them into a high risk category pertaining to cardiovascular disease. Also, as a person ages, one's blood pressure can change over time, thus it makes good "health sense" to monitor your blood pressure on a regular basis.

Blood Pressure Standard

The World Health Organization (WHO) has developed a blood pressure standard, according to which areas of low and high-risk blood pressure are identified. This standard, however, is a general guideline as individual blood pressure varies among different people and different age groups, etc.

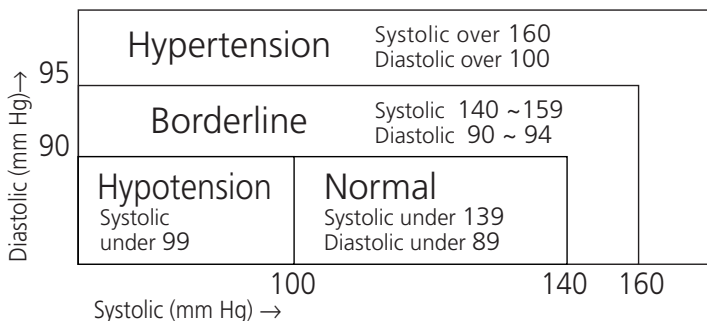


It is important that you consult with your physician regularly. Your physician can tell you your optimal blood pressure range.

Blood Pressure Fluctuation


Blood pressure fluctuates all the time!

Blood pressure will change over the course of the month, week and even throughout the day. It is also influenced by seasonal and temperature changes.

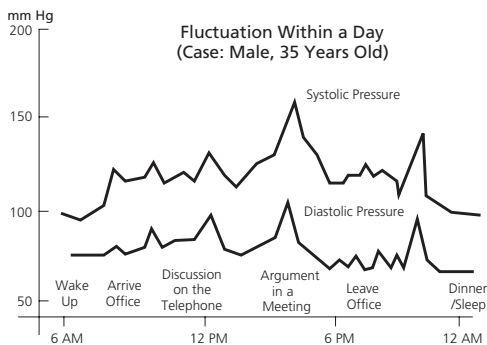

Display Explanations

Display:



Systolic Pressure

Diastolic Pressure

Pulse Rate

No. of Memory Sequence

Icons:

mem. *Appears when measurement value is stored in memory or is recalled from memory*



Appears when batteries should be replaced


min.  *Shows the Pulse Rate per minute*



Occurs when an error was made during measurement

Installing Batteries

1. Press down and lift the battery cover in the direction of the arrow to open the battery compartment.
2. Install or replace 4 "AA" 1.5 Volt batteries in the battery compartment according to the battery direction indicators molded on the inside of the compartment.
3. Replace the battery cover by inserting the bottom tabs first, then push in the top clip of the battery door until it engages.



You need to replace the batteries when:

1. The “low battery” icon appears on the display.
2. The “POWER” button is pushed and nothing appears on the display

Note:



Discard used Alkaline batteries as directed by your local environmental codes.

HOW TO USE:


Helpful Tips

Here are a few tips to help you obtain more accurate readings:

- Do not measure your blood pressure immediately after consuming a large meal. To obtain more accurate readings, please wait one hour before measuring.
- Do not smoke or drink alcohol before measuring your blood pressure.
- You should not be physically tired or exhausted when taking a measurement.
- It is important that you relax during measurement. Try to take a 15-minute rest before taking a reading.
- Do not take measurements if you are under stress or under tension.
- Take your blood pressure at normal body temperature. If you are feeling cold or hot, wait a while before taking a measurement.
- If the monitor is stored at very low temperature (near freezing), have it placed at a warm location for at least one hour before using it.
- **Wait about 5 minutes before taking a SECOND blood pressure measurement.**

Applying the Arm Cuff

1. Plug the cuff connector tube (A) into the unit.
2. Unwrap the arm cuff, leaving the “Index” end of the cuff through the metal D-ring (B) of the cuff.



3. Put your left arm through the cuff loop. The “OK” range indication should be positioned at the top with the rubber tube pointing downward in the direction of your forearm. **Position the artery mark [Φ] over the main arteries on the inside of your arm as shown in the figure below.** The tube should be running down the center of your arm.



4. Turn your left palm upward and place the edge of the arm cuff at approximately 1 inch above your elbow. Tighten the cuff by pulling the “Index” end of the cuff. The cuff should be tensioned onto the arm to allow the insertion of two fingers between the cuff and arm. If the tension on the cuff is too tight or too loose, it may result in an error “EE” message on the display.


5. **If the Index line falls within the OK range, indicated at the edge of the cuff, this cuff is suitable for your use.** If the Index line falls outside of the OK range, you may need a larger cuff for accurate measurement. Please consult your local retailer for the purchase of a larger cuff or visit the Health o meter® website at www.healthometer.com.




Sit in a chair with your feet flat on the floor. Rest your left arm on a table so that the arm cuff is at the same level as your heart.

Taking a Measurement

1. Press the POWER button. All display segments will appear for approximately one second before returning to "0."



2. The unit will automatically start to inflate slowly to measure your blood pressure. During inflation, a changing measure of the cuff pressure will be shown on the display.




3. **When cuff pressure reaches your approximate systolic blood pressure, measurement will be complete and will be followed by the release of cuff pressure.**

When the monitor completes the measurement, it will automatically display and store the systolic, diastolic and pulse reading into memory. The last **90 measurement readings will be saved into memory.**

4. Measurement is now complete. Press the POWER button to turn the unit off. The unit will automatically shut-off after 1 minute if no buttons are pressed.

Recalling Memory

1. To recall stored blood pressure readings from the memory, simply press the **MEMORY** button. The last set of readings recorded in memory will be displayed.



2. Another press of the **MEMORY** button will recall the previous set of readings.
3. All readings stored in memory will be displayed with their corresponding sequence number.

Note:

1. The data in the memory will not be lost even when the Blood Pressure Monitor is switched off.
2. You can erase the memories stored by removing the batteries.

Troubleshooting

If a problem should arise during use, please check the following points.

Symptom	Check Point	Correction
No display when the POWER button is pressed	Have the batteries run down?	Replace them with 4 new "AA" alkaline batteries
	Have the batteries been properly positioned in the compartment?	Re-insert the batteries in the correct position
EE mark shown on the display or the blood pressure value is displayed excessively low (or high)	Is the cuff tensioned correctly?	Wrap the cuff properly so that it is positioned correctly
	Is the cuff placed correctly?	Measure it again quietly
	Did you talk or move during the measurement?	
	Did you shake the arm with the cuff on it?	

Note: If the unit still does not work, please see the Warranty Information in this manual. Under no circumstance should you disassemble the unit and attempt repairs yourself.

Precautionary Notes:

1. Your Health o meter[®] monitor contains high-precision components. Therefore, avoid extreme temperatures, humidity, and direct sunlight. Avoid dropping or sharp impacts to the main unit, and protect it from dust.
2. Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly dampened soft cloth. Do not press on the unit too hard. Do not wash the cuff or use chemical cleaners on it. Never use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.
3. Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit is not used for an extended period of time.

4. To avoid hazardous situations, the unit should not be operated by children.
5. If the unit is stored near a freezing temperature, allow it to reach room temperature before use.
6. Your Health o meter® Blood Pressure Monitor is not field serviceable. You should not use any tool to open the device nor should you attempt to make any adjustments to it. If the monitor is not working properly, please contact Sunbeam Products, Inc., as outlined under the Warranty information in this manual.
7. For users diagnosed with common arrhythmia (*atrial or ventricular premature beats or atrial fibrillation*), diabetes, poor circulation of blood, kidney problems, or for users who have suffered from stroke, or for unconscious users, this device may not be suitable for use.
8. Your Health o meter® Blood Pressure Monitor, can be cleaned with a soft dry cloth. Never use an abrasive cleanser or submerge the device in water or other liquids.

Specifications:

Measurement Method	: Oscillometric
Measurement Range	: Pressure: 20 ~ 280 mm Hg; Pulse: 40 ~ 180 beats/minute
Pressure Sensor	: Semi Conductor
Accuracy	: Pressure: ± 3 mm Hg; Pulse: $\pm 5\%$ of reading
Inflation	: Pump Driven Inflation
Deflation	: Automatic Pressure Release Valve
Memory capacity	: 90-set memory
Auto-shut-off	: 1 minute after last button operation
Operation Environment	: Temperature: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F); Humidity: 40 ~ 85%
Storage Environment	: Temperature: -5°C ~ 60°C (23°F ~ 140°F); Humidity:10 ~ 95%
Power Source	: 6 Volts / Four 1.5 Volt DC (AA) Batteries
Dimensions	: 105 (L) x 160 (W) x 68 (H) mm
Weight	: 335 g (G.W.) (without Batteries)
Arm circumference	: Adult : 22 ~ 32 cm (8.7 ~ 12.6 inches) (standard) : Large Adult : 32 ~ 42 cm (12.6 ~ 16.5 inches) (optional)
K.B.	: Short time operation 2 minutes. : Classification of type BF

*To ensure accurate measurements, it is recommended that calibration be completed every two years.

**Specifications are subject to change without notice.

Warranty Information

Your Health o meter® Blood Pressure Monitor is covered under the limited Warranty offered by Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"). Sunbeam warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam Products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God or Nature, such as fire, flood, hurricane and/or tornado.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

For more information, or to obtain warranty service, contact Sunbeam Products, Inc. at 800 672-5625 or visit the Health o meter® website at www.healthometer.com

©2002 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc.
and ComfortRead™ is a trademark of Sunbeam Products, Inc.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, FL 33431.

Manual printed in Taiwan




Your Measure for Good Health™

DE BRAZO

Medidor de Presión Arterial

con

Tecnología ComfortRead™



NOTAS IMPORTANTES

Healthometer®

Medidor de Presión Arterial

con Tecnología ComfortRead™

INSTRUCCIONES DE MEDIDAS IMPORTANTES

NO DESTRUYA

Características:

- **Totalmente Automático**
- **Operación de Un Toque**
- **Pantalla Digital Extra Grande, Fácil de Leer**
- **Brinda 90 Memorias Automáticas**
- **Tecnología Comfort Read™ Minimiza la Presión de Brazaletes, Maximiza el Confort**
- **Caja de Almacenamiento Muy Conveniente**

De Conformidad con Estándares Internacionales:



Índice

Introducción	3-4
Identificación de los Componentes del Producto	4
Tecnología de Medición Comfort Read™	4
Estándares de Calidad	5
Acerca de la Presión Arterial	5
Estándar de Presión Arterial	6
Fluctuaciones de la Presión Arterial	6
Descripción de la Pantalla	7
Instalación de las Baterías	7-8
COMO SE USA	8-11
• Consejos Útiles	8
• Colocación del Brazaletes	9-10
• Tomando una Medición	10-11
• Lectura de las Memorias	11-12
Solución de Problemas	12
Precauciones	12-13
Especificaciones	13
Información Sobre la Garantía	14

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo Monitor de Presión Arterial de Brazo Health o meter® Modelo 7631. Este aparato totalmente automático es fácil de usar y muy adecuado para tomar mediciones diarias. La pantalla grande incluye la medición sistólica, la diastólica y la del pulso, todas ellas mostradas claramente una vez que se completa cada lectura.

Además, usted puede almacenar hasta 90 mediciones utilizando la característica de memoria incorporada que tiene el monitor, lo cual es ideal para aquellos usuarios que desean mantener el control y seguimiento de su presión arterial en una manera regular. El monitor de presión arterial Health o meter® es portátil, lo cual lo hace ideal para el uso en el hogar y también durante los viajes.

grandemente aumentado.

Estándares de Calidad

Este Monitor de Presión Arterial se ajusta al Instituto de Estándares Nacional Americano / Asociación Americana de Estándares de Instrumentos Médicos para Monitores de Presión Arterial No-Invasivos. Además, el aparato cumple con las regulaciones Europeas y lleva el sello "CE 0366" de la CE. La calidad de este aparato ha sido verificada y se ajusta a las previsiones de la directiva 93/42/EEC del Consejo CE de fecha 14 de Junio de 1993 respecto a aparatos médicos, así como la directiva 89/336/EEC de la EMC.

ANSI/AAMI SP10	Esfigmomanómetros Electrónicos o automáticos
EN 1060-1 (Dic. 1995)	Equipo de medición de la presión arterial no-invasivo Requerimientos Generales
EN 1060-3 (Feb. 1997)	Equipo de medición de la presión arterial no-invasivo Requerimientos suplementarios para sistemas electromecánicos de medición de la presión arterial

ACERCA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

¿Qué es la Presión Arterial?


La presión arterial es la presión ejercida contra el interior de la pared arterial durante el flujo de la sangre a través de la arteria. La presión medida cuando el corazón se contrae y envía la sangre fuera del corazón es la lectura "sistólica" (el número más alto) La presión medida cuando el corazón se dilata con la sangre fluyendo hacia adentro del corazón es llamada la presión arterial "diastólica" (número más bajo)

¿Para qué se Mide la Presión Arterial?

Varios problemas de la salud relacionados con la presión alta son muy comunes entre la gente de la sociedad actual. Hay una significativa interrelación entre la presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares. Esta correlación ha hecho que la medición de la presión arterial sea una necesidad para aquellos individuos identificados con presión arterial elevada, colocándolos en la categoría de alto riesgo respecto a las enfermedades cardiovasculares. Además, conforme envejecen las personas, su presión arterial puede cambiar con el tiempo, lo cual hace que sea muy sensato monitorear su presión arterial en una forma regular.

Estándar de Presión Arterial

La Organización Mundial de la Salud (WHO) ha desarrollado un estándar de presión arterial, de acuerdo al cual se han identificado las áreas de alto y bajo riesgo de la presión arterial. Este estándar, sin embargo, es un lineamiento general porque la presión arterial del individuo cambia de una persona a otra y en los diferentes grupos de edades diferentes, etc.

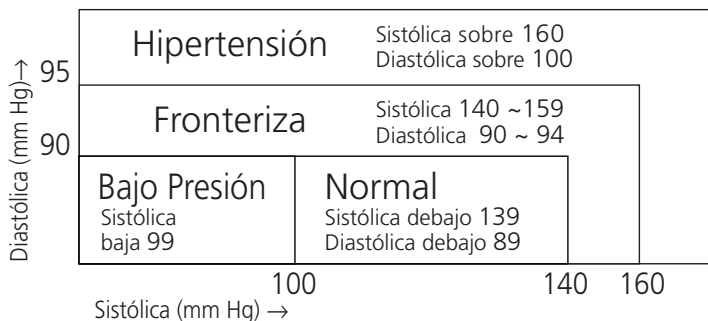


Es importante que usted consulte con su médico regularmente. Su médico puede decirle cuál es su óptimo rango de presiones arteriales.

Fluctuaciones de la Presión Arterial


¡La presión arterial fluctúa todo el tiempo!

La presión arterial cambiará a lo largo del mes, de la semana y aún a lo largo de un día. También influyen los cambios de estaciones y de temperaturas.

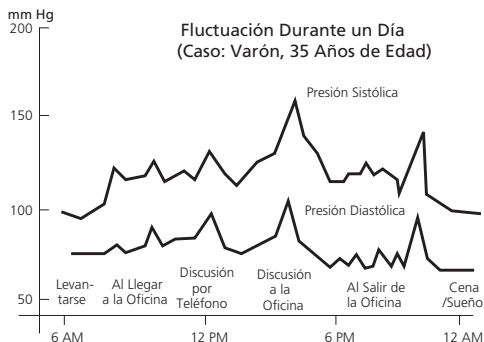

Descripciones de la Pantalla

Pantalla:



Presión Sistólica

Presión Diastólica

Pulso



No. de Secuencia de La Memoria

Símbolos:

mem. Aparece cuando el valor de la medición es almacenada en memoria o es requerida de la memoria



Aparece cuando las baterías deben ser reemplazadas




Muestra el pulso Por minuto



Ocurre cuando se ha cometido un error durante la medición

Instalación de las Baterías

1. Presione y levante la tapa de las baterías en la dirección de la flecha para abrir el compartimiento de baterías.
2. Instale o reemplace 4 baterías de 1.5 V tipo "AA" en el compartimiento de baterías de acuerdo con los indicadores de dirección de baterías estampadas en el interior del compartimiento.
3. Reinstale la tapa de las baterías insertando las orejetas inferiores primero, luego empuje la parte alta del clip de la tapa de baterías hasta que enganche.



Usted debe cambiar baterías cuando:

1. El símbolo de “batería baja” aparece en la pantalla.
2. Usted presiona el botón “POWER” y no aparece nada en la pantalla

Nota:



Descarte las baterías Alcalinas usadas como lo indican las normas ambientales locales.

COMO SE USA:


Consejos Utiles

Aquí le damos unos consejos útiles para ayudarle a obtener lecturas más exactas:

- No mida su presión arterial inmediatamente después de ingerir una comida copiosa. Para obtener lecturas más exactas, por favor espere una hora antes de medirse.
- No fume ni ingiera alcohol antes de medirse la presión arterial.
- No se tome la medición cuando usted esté físicamente agotado o cansado.
- Es importante que usted se relaje cuando se toma la medición. Procure tomar un descanso de unos 15 minutos antes de tomarse la lectura.
- No se tome mediciones si usted se encuentra en estrés o bajo tensiones.
- Tómese la presión arterial a una temperatura corporal normal. Si usted se siente con frío o con calor, espere un poco antes de tomarse la medición.
- Si el monitor está almacenado a temperaturas muy bajas (cerca del punto de congelación), manténgalo en un lugar tibio por lo menos una hora antes de usarlo.
- **Espere cerca de 5 minutos antes de tomar una SEGUNDA medición de la presión arterial.**

Colocación del Brazaletes en el Brazo

1. Enchufe el tubo (A) conector del brazalete en la unidad.
2. Desenvuelva el brazalete de brazo, dejando el extremo "Índice" del brazalete a través del anillo en D (B) del brazalete.



3. Pase su brazo izquierdo entre el aro que forma el brazalete. El indicador de alcance "OK" debe ser puesto encima con el tubo de jebes apuntando hacia abajo en la dirección de su antebrazo. Coloque la señal de arteria [] sobre las arterias principales en el lado interior de su brazo como se muestra en la figura de abajo. El tubo debe correr hacia abajo por el centro de su brazo.



4. Voltee su palma izquierda hacia arriba y coloque el borde del brazalete de brazo a aproximadamente 1 pulgada por encima de su codo. Ajuste el brazalete jalando el extremo "Índice" del brazalete. El brazalete debe ser ajustado sobre el brazo de modo de permitir la inserción de dos dedos entre el brazalete y el brazo. Si la tensión en el brazalete está muy apretada o muy floja, se puede presentar un mensaje de error "EE" en la pantalla.


5. **Si la línea de Índice cae dentro del espacio OK, indicado en el borde del brazalete, este brazalete es adecuado para su empleo.** Si la línea de Índice cayera fuera del rango OK, es muy posible que usted requiera un brazalete más grande para obtener una medición precisa. Por favor consulte con su distribuidor local para comprar un brazalete más grande o visite las páginas de Internet del Health o meter® en el www.healthometer.com.




Siéntese en una silla con los pies planos en el piso. Descanse su brazo izquierdo sobre una mesa de modo que el brazalete de brazo esté al mismo nivel que su corazón.

Tomando una Medición

1. Presione el botón POWER. Todos los segmentos de pantalla aparecerán por más o menos un segundo antes de volverse un "0".



2. La unidad empezará a inflarse automáticamente y lentamente para medir su presión arterial. Durante el inflado, la presión cambiante del brazalete será mostrada en la pantalla.



Nota:

1. Los datos de la memoria no se perderán aún cuando se apagara el Monitor de Presión Arterial.
2. Para borrar la memoria almacenada, remueve las baterías.

Solución de Problemas

Si se presentara algún problema durante el uso, por favor verifique los siguientes puntos.

Síntoma	Punto a Verificar	Solución
Ninguna exhibición de pantalla cuando se presiona POWER	¿Están agotadas las baterías?	Reemplácelas con 2 baterías alcalinas nuevas tamaño "AA"
	¿Han sido colocadas las baterías en la posición correcta dentro del compartimiento?	Re-inserte las baterías en posición correcta
La pantalla muestra la señal EE o el valor de presión arterial mostrado es demasiado bajo (o alto)	¿Está el brazaletes colocado correctamente?	Envuelva el brazaletes apropiadamente de modo que esté bien posicionado y con la tensión correcta
	¿Está correctamente tensado el brazaletes?	
	¿Habló usted o se movió durante la medición?	Mida de nuevo con más tranquilidad
	¿Agitó usted su brazo estando con el brazaletes colocado?	

Nota: Si la unidad todavía no funciona bien, por favor vea la Información de Garantía en este manual. Bajo ningún motivo desarme usted la unidad ni intente hacerle reparaciones usted mismo.

Precauciones

1. Su monitor Health o meter® contiene componentes de alta precisión. Por lo tanto, evite las temperaturas y la humedad extremas y los rayos directos del sol. Evite dejar caer o los impactos agudos contra la unidad principal, y protéjala contra el polvo.
2. Limpie cuidadosamente el cuerpo del monitor de presión arterial y el brazaletes con un paño suave ligeramente humedecido. No presione la unidad con mucha fuerza. No lave el brazaletes ni utilice limpiadores químicos. Nunca utilice solvente (thinner), alcohol ni derivados del petróleo (gasolina) como limpiador.
3. Las baterías con fugas pueden dañar la unidad. Quite las baterías cuando la unidad no esté en uso por un largo período de tiempo.

4. Para evitar situaciones peligrosas, la unidad no debe ser operada por niños.
5. Si la unidad estuviera almacenada cerca a la temperatura de congelación, deje que alcance primero la temperatura de la habitación antes de emplearla.
6. Su Monitor de Presión Arterial Health o meter® no puede ser reparado por el usuario. Usted no debe utilizar ninguna herramienta para abrir la unidad ni tampoco debe intentar hacerle ningún tipo de ajustes. Si el monitor no estuviera funcionando apropiadamente por favor contacte a Sunbeam Products, Inc. como se describe más abajo en Información de Garantía de este manual.
7. Para los usuarios diagnosticados con arritmia común (latidos prematuros del atrio o ventriculares o fibrosis del atrio), diabetes, mala circulación o problemas de la sangre o de los riñones, o para los usuarios que hayan sufrido de derrames, o los usuarios inconscientes, este artefacto puede no ser adecuado para usted. Por favor consulte con su médico antes de su empleo.
8. Se puede hacer limpieza de su Monitor de Presión Arterial Health o meter, con un paño suave seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Especificaciones:

Método de Medición	: Oscilométrico
Rango de Medición	: Presión 20 ~ 280 mm Hg; Pulso: 40 ~ 180 latidos/minuto
Sensor de Presión	: Semi conductor
Precisión	: Presión \pm 3 mm Hg; Pulso: \pm 5% de lectura
Inflación	: Inflado por Medio de una Bomba
Desinflado	: Válvula de Desfogue de Presión Automática
Capacidad de Memoria	: Memoria de 90 juegos de datos
Se apaga automáticamente	: 1 minuto después de la última operación del botón
Ambiente de Operación	: Temperatura: 10°C – 40°C (50°F – 104°F); Humedad: 40 – 85%
Condiciones del Ambiente de Almacenamiento	: Temperatura : -5°C – 60°C (23°F – 140°F) : Humedad: 10 – 95%
Fuente de Alimentación	: 6 Voltios / Cuatro Baterías (AA) de 1.5 Voltios CD
Dimensiones	: 105 (L) X 160 (W) X 68 (H) mm
Peso	: 335 g (sin Baterías)
Circunferencia del Brazo	: Adulto: 22 ~ 32 cm (8.7 pu. ~ 12.6 pu.) (estándar) : Adulto grande: 32 ~ 42 cm (12.6 pu. ~16.5 pu.) (opcional)
K.B	: Operación breve de 2 minutos. : Clasificación de tipo BF

**Para estar seguro de la exactitud de las mediciones, se recomienda que se haga una calibración completa cada dos años.*

***Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*

Información Sobre la Garantía

Su Monitor de Presión Arterial Health o meter® está cubierto por la Garantía limitada ofrecida por Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"). Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de la compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. Sunbeam, a su opción, reparará o substituirá este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no estuviera disponible, el reemplazo se puede hacer con un producto similar de valor igual o mayor. Esta es su exclusiva garantía. Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de compra al por menor y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. La prueba de la compra se requiere para obtener la validez de la garantía. Los distribuidores, los centros de servicio o las tiendas al por menor Sunbeam que venden productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o de ningún modo cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración por cualquier persona con excepción de Sunbeam o de un centro de servicio autorizado. Aún más, la garantía no cubre los Actos de Dios o de la Naturaleza, tales como los incendios, las inundaciones, huracanes y / o tornados.

Sunbeam no será responsable por ningún daño fortuito o consecuente causado por el incumplimiento de cualesquiera garantías expresas o implícadas. Excepto hasta donde lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícada de comerciabilidad o la adecuación para un propósito particular se limita en la duración a la duración de la garantía antedicha. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícada, de modo que las limitaciones o exclusión anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varíen de estado a estado o de provincia a provincia.

Para mayor información, o para obtener servicio de garantía, contacte a Sunbeam Products, Inc. en el 1 800 672-5625 o visite las páginas de Internet de Health o meter® website en www.healthometer.com

©2002 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc.
y ComfortRead™ es una marca comercial de Sunbeam Products, Inc.
Distribuida por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, FL 33431.

Manual impreso en Taiwan.