

OMRON®

INSTRUCTION MANUAL



Automatic Blood Pressure Monitor with ComFit™ Cuff Model HEM-780



ESPAÑOL

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

Before Using the Monitor

Introduction	4
Safety Information	5
Operating the Device	5
Risk of Electrical Shock	6
Care and Maintenance	7
Before Taking a Measurement	8

Operating Instructions

Know Your Unit	9
Unit Display	10
Display Symbols	11
Irregular Heartbeat Symbol	11
Movement Error Symbol	11
USER ID Symbol	11
Morning Hypertension Symbol	12
Heartbeat Symbol	13
Average Value Symbol	13
Morning Average Symbol	13
Evening Average Symbol	13
Battery Installation	14
Using the AC Adapter	16
Setting the Date and Time	18
Applying the Arm Cuff	22

TABLE OF CONTENTS

Taking a Measurement	26
Using the Guest Mode	26
Selecting the USER ID	27
Using the USER ID	27
Selecting the TruRead™ Mode	28
Using the Single Mode	30
Using the TruRead™ Mode	33
Special Conditions	35
Using the Memory Function	36
Averaging Function	36
To Display the Measurement Values	37
Morning and Evening Averages	39
Morning Averages	39
Evening Averages	39
To Display Morning and Evening Averages	40
Display Combinations	41
To Delete All Values Stored in the Memory	42
Care and Maintenance	
Care and Maintenance	43
Error Indicators and Troubleshooting Tips	45
FCC Statement	47
Warranty	48
Specifications	49
Notes	50

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Omron® HEM-780 IntelliSense® Automatic Blood Pressure Monitor with ComFit™ Cuff.

Fill in for future reference.

DATE PURCHASED: _____

SERIAL NUMBER: _____

Staple your purchase receipt here

Your new digital blood pressure monitor uses the oscillometric method of blood pressure measurement. This means the monitor detects your blood's movement through your brachial artery and converts the movements into a digital reading. The monitor stores measurement results for two people and features Morning and Evening Averages. TruRead™ allows for three consecutive measurements with timed intervals for an average reading.

The HEM-780 comes with the following components:

- Monitor • ComFit™ Cuff • AC Adapter
- 4 "AA" Batteries • Storage Case
- Instruction Manual printed in English and Spanish
- Warranty Card

The HEM-780 IntelliSense® Automatic Blood Pressure Monitor is intended for home use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To assure the correct use of the product basic safety measures should always be followed including the warnings and cautions listed in this instruction manual.

SAFETY SYMBOLS USED IN THIS INSTRUCTION MANUAL

 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the equipment or other property.

OPERATING THE DEVICE

- ▲ Contact your physician for specific information about your blood pressure. Self-diagnosis and treatment using measured results may be dangerous. Follow the instructions of your physician or licensed healthcare provider.
- ▲ If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Contact a physician immediately.
- ▲ Read all of the information in the instruction manual and any other literature in the box before operating the unit.
- ▲ This device is intended for use in measuring blood pressure and pulse rate in the adult population. Do not use this device on infants or persons who cannot express their intentions.

SAFETY INFORMATION

- ⚠ Read the Special Conditions section (page 35) of the instruction manual if your systolic pressure is known to be more than 220 mmHg. Inflating to a higher pressure than necessary may result in bruising where the cuff is applied.
- ⚠ Operate the device only as intended. Do not use the device for any other purpose.
- ⚠ Dispose of the device, components and optional accessories according to applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.
- ⚠ Do not use a cellular phone near the device. It may result in an operational failure.
- ⚠ Use only Omron authorized parts and accessories. Parts and accessories not approved for use with the device may damage the unit.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- ⚠ Do not plug or unplug the power cord into the electrical outlet with wet hands.
- ⚠ Do not overload power outlets. Plug the device into the appropriate voltage outlet.

SAFETY INFORMATION

CARE AND MAINTENANCE

- ⚠ Do not subject the monitor to strong shocks, such as dropping the unit on the floor.
- ⚠ Do not submerge the device or any of the components in water.
- ⚠ Store the device and the components in a clean, safe location.
- ⚠ Changes or modification not approved by Omron Healthcare will void the user warranty.


BEFORE TAKING A MEASUREMENT

To ensure a reliable reading follow these recommendations:

1. Avoid eating, smoking, exercising, and bathing for 30 minutes before taking a measurement. Rest for at least 15 minutes before taking the measurement.
2. Stress raises blood pressure. Avoid taking measurements during stressful times.
3. Measurements should be taken in a quiet place.
4. Remove tight-fitting clothing from your arm.
5. Sit in a chair with your feet flat on the floor. Rest your arm on a table so that the cuff is at the same level as your heart.
6. Remain still and do not talk during the measurement.
7. Keep a record of your blood pressure and pulse readings for your physician. A single measurement does not provide an accurate indication of your true blood pressure. You need to take and record several readings over a period of time. Try to measure your blood pressure at about the same time each day for consistency.


KNOW YOUR UNIT

Main Unit:

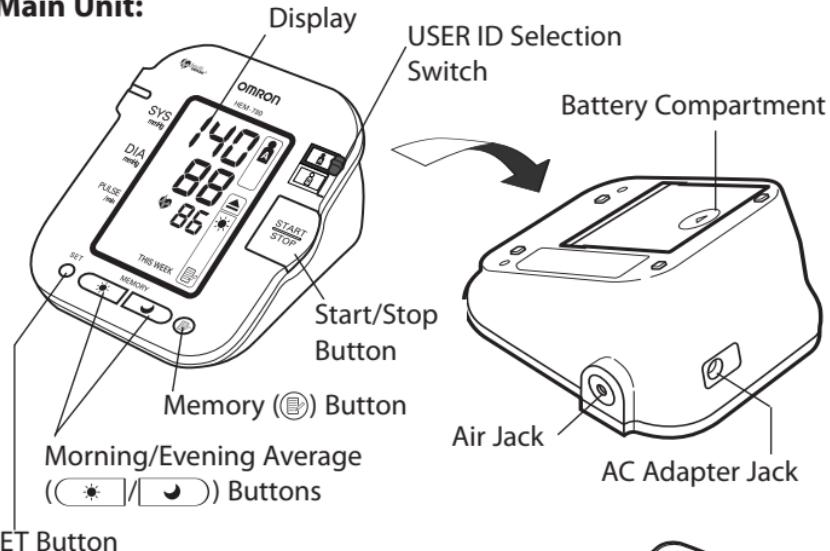

SET Button

Components:

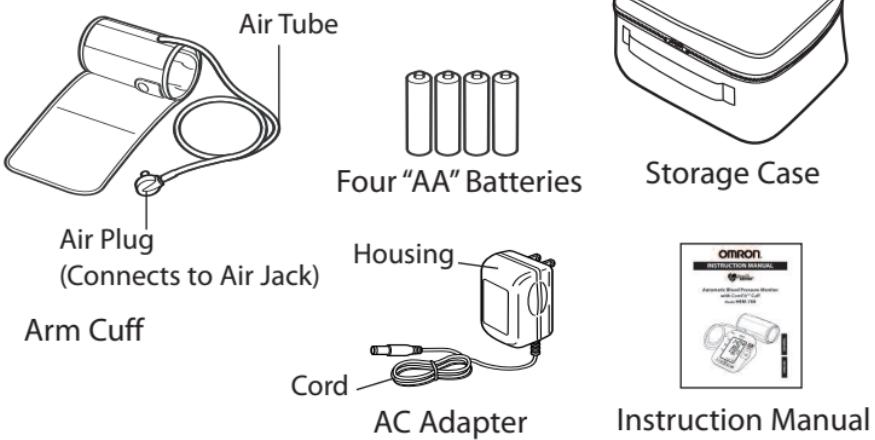


Arm Cuff

Air Plug
(Connects to Air Jack)

Cord

Housing
AC Adapter

UNIT DISPLAY

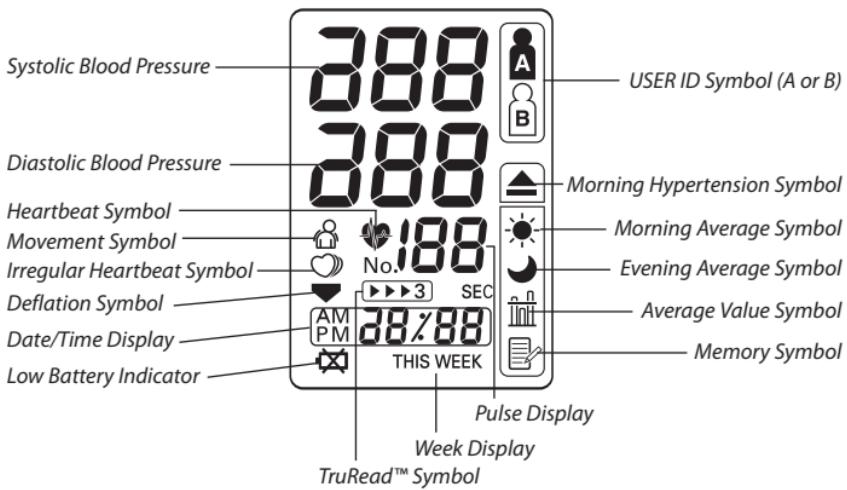


DISPLAY SYMBOLS

IRREGULAR HEARTBEAT SYMBOL (⌚)

When the monitor detects an irregular rhythm two or more times during the measurement, the Irregular Heartbeat Symbol (⌚) will appear on the display with the measurement values.

An irregular heartbeat rhythm is defined as a rhythm that varies by less than 25% from the average rhythm or 25% more than the average rhythm detected while the monitor is measuring the systolic and diastolic blood pressure.

If the irregular heartbeat symbol (⌚) displays with your measurement results, we recommend you consult your physician. Follow the directions of your doctor.

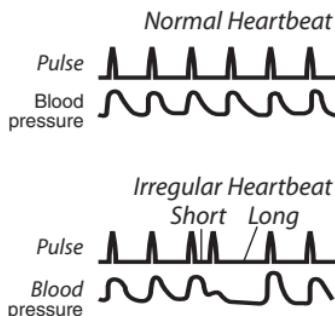

MOVEMENT ERROR SYMBOL (✖)

The Movement Error Symbol is displayed if you move your body during the measurement. Please remove the arm cuff, and wait 2-3 minutes. Take another measurement.

USER ID SYMBOL (Ⓐ / Ⓛ)

The USER ID Symbol indicates USER A or USER B as selected by the user to take a measurement or when using the memory function. The USER ID Symbol is not displayed when using the Guest Mode to take a measurement.

DISPLAY SYMBOLS

The American Heart Association¹ recommends the following guideline for upper limit of normal for home blood pressure readings:

AHA Home Guideline for Upper Limit of Normal BP	
Systolic Blood Pressure	135 mmHg
Diastolic Blood Pressure	85 mmHg

This is a general guideline because blood pressure depends on age and morbidity. The AHA recommends a lower home blood pressure goal for certain patients, including diabetic patients, pregnant women, and patients with renal failure¹.

The monitor is not intended to be a diagnostic device.

⚠ WARNING

Contact your physician for specific information about your blood pressure. Self-diagnosis and treatment using measured results may be dangerous. Follow the instructions of your physician or licensed healthcare provider.

Omron Healthcare recommends you contact your physician if the MORNING HYPERTENSION SYMBOL and/or the HEARTBEAT SYMBOL appear on the display with your measurement values.

MORNING HYPERTENSION SYMBOL (▲)

The Morning Hypertension Symbol is displayed if the morning average reading for a week is above 135 for the Systolic Blood Pressure value and/or 85 for the Diastolic Blood Pressure value when viewing the Morning Averages and the Evening Averages in the memory.

¹American Heart Association Scientific Statement 2004

DISPLAY SYMBOLS

HEARTBEAT SYMBOL ()

TAKING A MEASUREMENT

The Heartbeat Symbol flashes on the display during the measurement. The Heartbeat Symbol flashes at every heartbeat.

When the measurement is complete, the Heartbeat Symbol flashes on the display with your blood pressure and pulse rate if the reading is above 135 for the Systolic Blood Pressure value and/or 85 for the Diastolic Blood Pressure value.

USING THE MEMORY FUNCTION

The Heartbeat Symbol flashes when the blood pressure reading stored in the memory is above 135 for the Systolic Blood Pressure value and/or 85 for the Diastolic Blood Pressure value.

AVERAGE VALUE SYMBOL ()

The Average Value Symbol is displayed when you press the memory button. The most recent average reading appears on the display screen.

MORNING AVERAGE SYMBOL ()



The Morning Average symbol is displayed when viewing Morning Averages using the Memory Function.

EVENING AVERAGE SYMBOL ()

The Evening Average symbol is displayed when viewing Evening Averages using the Memory Function.

BATTERY INSTALLATION

1. Press the ▼ indicator on the battery cover and slide the cover off in the direction of the arrow.
2. Install 4 "AA" size batteries so the + (positive) and - (negative) polarities match the polarities of the battery compartment as indicated.
3. Replace the battery cover.

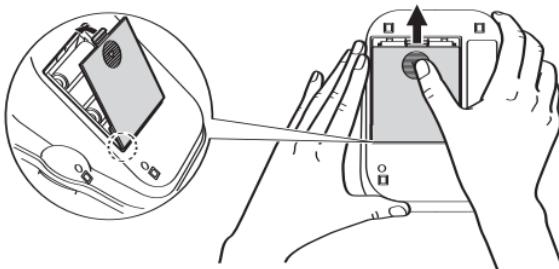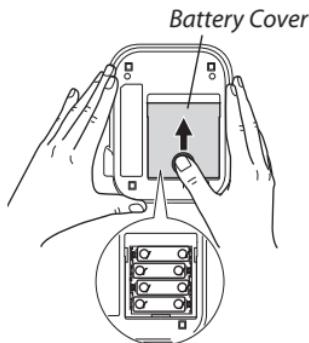

BATTERY INSTALLATION

BATTERY REPLACEMENT



Low Battery Indicator

When the Low Battery Indicator appears on the display screen turn the monitor off and remove all the batteries. Replace with four new batteries at the same time. Longlife alkaline batteries are recommended.

⚠ CAUTION

If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Contact a physician immediately.

- NOTES:**
- Turn the unit off before replacing the batteries. If the batteries are removed while the unit is still on, the date and time will be reset to that of the previous use. However, the measurement results are not deleted.
 - When the batteries are replaced, you may need to reset the date and time. If the year is flashing on the display screen, refer to page 21, RESETTING THE DATE AND TIME.
 - The supplied batteries may have a shorter life.

⚠ CAUTION

Dispose of the device, components and optional accessories according to applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.

USING THE AC ADAPTER

Use only the authorized Omron AC Adapter, Model Number HEM-ADPT1, with this monitor.

We recommend you install the batteries even if the AC Adapter is used. If no batteries are installed, you may need to reset the date and time if the AC Adapter is disconnected. The measurement results will not be deleted.


⚠ CAUTION

Use only Omron authorized parts and accessories. Parts and accessories not approved for use with the device may damage the unit.

USING THE AC ADAPTER

TO CONNECT THE AC ADAPTER

- ① Insert the AC Adapter Plug into the AC Adapter Jack on the back side of the monitor as illustrated.
- ② Plug the AC Adapter into a 120V AC outlet (60 cycles).

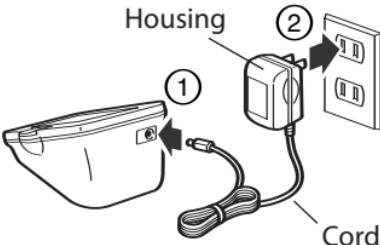

TO DISCONNECT THE AC ADAPTER

- ① Hold the Housing to remove the AC Adapter from the electrical outlet.
- ② Remove the AC Adapter plug from the monitor.

⚠ WARNING

Do not plug or unplug the power cord into the electrical outlet with wet hands.

⚠ CAUTION

Do not overload power outlets. Plug the device into the appropriate voltage outlet.

SETTING THE DATE AND TIME

Set the monitor to the current date and time before taking a measurement for the first time. If the date and time are not set correctly, the measurement values stored in the memory and the average values may not be correct.


The Blood Pressure Monitor automatically stores up to 84 individual measurements values with the dates and times. The monitor also calculates weekly averages for measurements in the morning and in the evening. Morning and evening averages are stored for this week and the last seven weeks.

The monitor can also calculate an average reading based on the three most recent measurements taken within 10 minutes of the last reading.


- NOTES:**
- If only two readings are stored in the memory for the 10-minute period, the average is based on the two readings.
 - If one reading is stored in the memory for the 10-minute period, this reading is displayed as the average.

1. TO START THE SETTING

Press and hold the SET button to adjust the date and time.



The year flashes on the display.



SETTING THE DATE AND TIME

2. SETTING THE YEAR

The year can be set between 2006 and 2030. When the display reaches 2030, it will return to 2006.

Press the Memory button (⌚) to advance by increments of one year.

Press the SET button to set the current year.

The month flashes on the display.



NOTE: Press and hold the Memory button (⌚) to advance the date and time values faster.

3. SETTING THE MONTH

Press the Memory button (⌚) to advance by increments of one month.

Press the SET button to set the current month.

The day flashes on the display.



SETTING THE DATE AND TIME

4. SETTING THE DAY

Press the Memory button (⌚) to advance by increments of one day.

Press the SET button to set the current day.

The hour flashes on the display.



5. SETTING THE HOUR

The time is set using AM or PM.

Press the Memory button (⌚) to advance by increments of one hour.

Press the SET button to set the current hour.

The minute flashes on the display.



6. SETTING THE MINUTE

Press the Memory button (⌚) to advance by increments of one minute.

Press the SET button to set the minute setting.

7. TO TURN THE MONITOR OFF

Press the START/STOP button.

NOTE: The monitor will automatically turn off after the minute has been set after battery replacement.

SETTING THE DATE AND TIME

RESETTING THE DATE AND TIME

To adjust the date or time after it has been setup when you first use the unit:

Start with the monitor in the off position.

1. Press and hold the SET button.

The TruRead™ symbol  and the current setting (**on** or **oFF**) will appear on the display for the USER ID selected.

To change the **on** or **oFF** setting press the Memory button, then press the SET button.

The interval time flashes on the display. Press the Memory button to select the desired interval time, then press the SET button.

The year flashes on the display.

2. Refer to page 18, Setting the Date and Time.

NOTE: If you need to change the Date and Time, always adjust the Date and Time setting before taking the next measurement.

APPLYING THE ARM CUFF

⚠ CAUTION


Read all of the information in the instruction manual and any other literature in the box before operating the unit.

⚠ CAUTION


This device is intended for use in measuring blood pressure and pulse rate in the adult population. Do not use this device on infants or persons who cannot express their intentions.

APPLYING THE CUFF ON THE LEFT ARM

1. Make sure the air plug is securely inserted in the main unit.

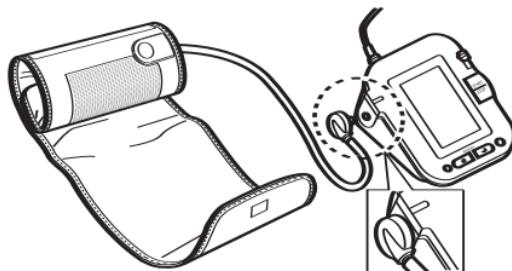


2. Remove tight-fitting clothing from your upper left arm.



APPLYING THE ARM CUFF


3. Sit in a chair with your feet flat on the floor. Place your left arm on a table so the cuff is level with your heart.

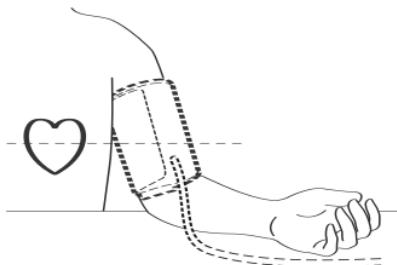

4. Hold the grip on the cuff securely with your right hand, placing your thumb on the thumb grip.




5. Turn the palm of your left hand upward.

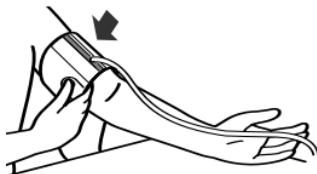


APPLYING THE ARM CUFF

6. Apply the cuff to your left upper arm so the blue strip is on the inside of your arm and aligned with your middle finger. The air tube runs down the inside of your arm. The bottom of the cuff should be approximately 1/2" above your elbow.

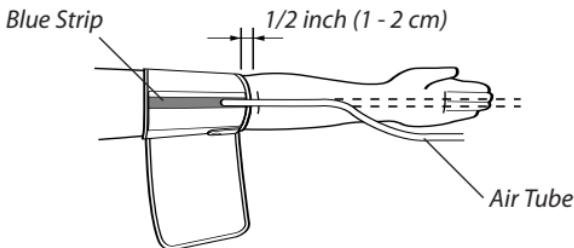

7. Wrap the cuff firmly in place around your arm using the cloth strip.




APPLYING THE ARM CUFF

APPLYING THE CUFF ON THE RIGHT ARM

When taking a measurement using the right arm use this instruction for Step 6 on page 24.

Apply the cuff to your right upper arm so the thumb grip is centered on the inside of your inner arm. The bottom of the cuff should be approximately 1/2" above your elbow.

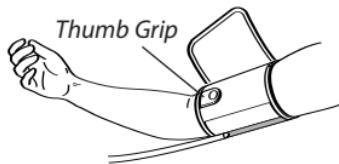

NOTE: Be careful not to rest your arm on the air tube. This will restrict the flow of air to the cuff.

TAKING A MEASUREMENT

The monitor is designed to take measurements and store the measurement values in the memory for two people using USER ID A and USER ID B.

The monitor can also be used to take a single measurement for other persons using the GUEST Mode. The USER ID symbol is not displayed when using the GUEST Mode. Measurements taken using the GUEST Mode are not stored in the memory.


⚠ CAUTION

Operate the device only as intended. Do not use the device for any other purpose.

USING THE GUEST MODE

1. Press and hold the START/STOP button.

The A and B Symbols disappear from the display.

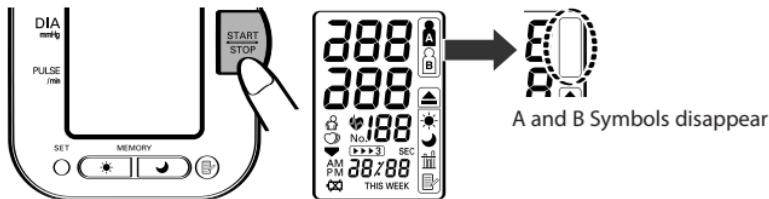

2. Release the START/STOP button.

The cuff starts to inflate automatically.

NOTE: To stop the inflation press the START/STOP button.

The monitor will stop inflating, start deflation and turn off.


TAKING A MEASUREMENT

- Inflation stops and the measurement is started. When the measurement is completed, your blood pressure and pulse rate appear on the display.

SELECTING THE USER ID

Select your USER ID. Always use the same USER ID when taking a measurement. The monitor stores the measurement values in the memory by the USER ID selected. These measurement values are used to calculate the Morning Averages and Evening Averages.

Slide the USER ID Selection Switch up or down to select USER A or B.

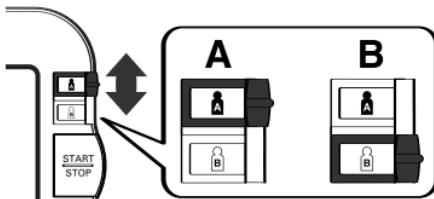

USING THE USER ID

When you select a USER ID the monitor can be set to take one measurement using the Single Mode or three consecutive measurements using the TruRead™ Mode when you press the START/STOP button.


NOTE: The default value is set to the Single Mode to take one measurement.

The TruRead™ Mode takes three consecutive measurements. The monitor will inflate, take a measurement, and deflate three times separated by a short interval of time between each measurement.

TAKING A MEASUREMENT


SELECTING THE TruRead™ MODE

1. Select your USER ID (A or B).

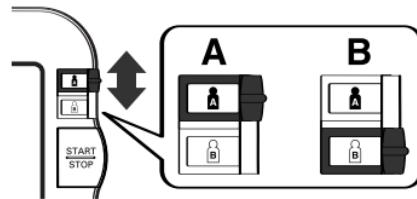


2. Press and hold the SET button.

The TruRead™ symbol and the **oFF** setting appears on the display.

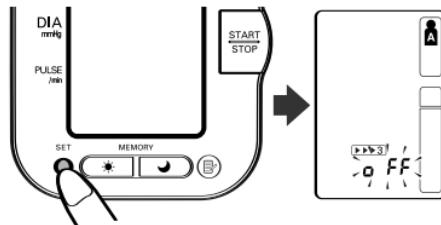


3. Press the Memory button () to select on.

NOTE: Press the Memory button to alternate between **on** and **oFF**.

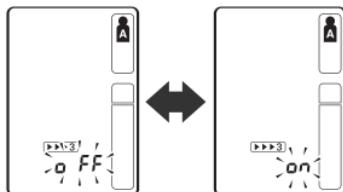

TAKING A MEASUREMENT

4. Press the SET button to confirm the change.

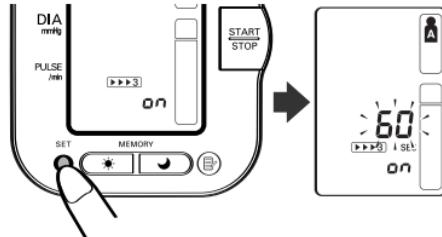

The number of seconds between each measurement is displayed.


NOTE: The default value between each measurement is 60 seconds.

5. Press the MEMORY button (⌚) to change the interval of time between each measurement.

The interval can be set to 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds or 120 seconds. Continue to press the MEMORY button until the desired interval appears on the display.

6. Press the SET button to confirm the setting.


The year flashes on the display.



TAKING A MEASUREMENT

7. If the date and time are correct, press the START/STOP button to turn the monitor off.

To change the date and time refer to page 18, SETTING THE DATE AND TIME.




⚠ CAUTION

Do not use a cellular phone near the device. It may result in an operational failure.

USING THE SINGLE MODE

1. Select your USER ID (A or B).

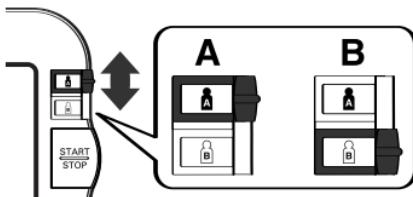


TAKING A MEASUREMENT

2. Press the START/STOP button.

All symbols appear on the display. The USER ID Symbol you selected flashes on the display.

The cuff starts to inflate automatically. As the cuff inflates, the monitor automatically determines your ideal inflation level. This monitor detects the pulse during inflation. Do not move your arm and remain still until the entire measurement process is completed.

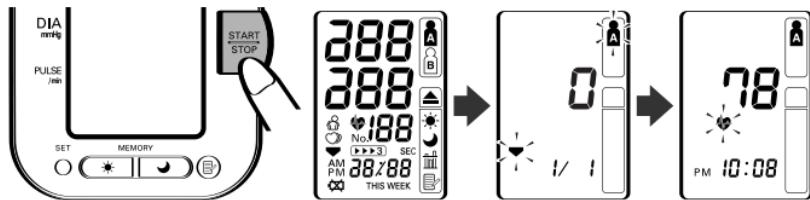

NOTE: To stop the inflation or measurement, press the START/STOP button. The monitor will stop inflating, start deflating and will turn off.

3. Inflation stops automatically and the measurement is started.

As the cuff deflates, decreasing numbers appear on the display. The Heartbeat Symbol (之心) flashes at every heartbeat.




TAKING A MEASUREMENT

- When the measurement is complete, the arm cuff completely deflates. Your blood pressure and pulse rate are displayed.



- Press the START/STOP button to turn the monitor off.

NOTE: The monitor will automatically turn off after five minutes.



TAKING A MEASUREMENT

USING THE TruRead™ MODE

1. Select your USER ID (A or B).
2. Press the START/STOP button.

All symbols appear on the display. The USER ID Symbol you selected flashes on the display.

The cuff starts to inflate automatically.

NOTE: To stop the inflation or measurement, press the START/STOP button. The monitor will stop inflating, start deflating and will turn off.


3. Inflation stops automatically and the measurement is started. As the cuff deflates, decreasing numbers appear on the display. The Heartbeat Symbol () flashes at every heartbeat. When the measurement is complete, the arm cuff completely deflates.

NOTE: Do not move your arm and remain still until the entire measurement process is completed.

4. Check the progress of the consecutive measurements.


NOTE: If a measurement fails, the monitor will repeat taking a measurement up to five times during the consecutive measurement process.

The first measurement is complete, waiting to start the next measurement. The interval of time set between each measurement will appear on the display.

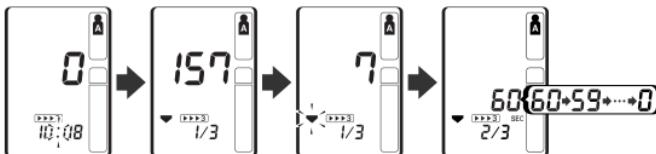


TAKING A MEASUREMENT

The second measurement is complete, waiting to start the next measurement.

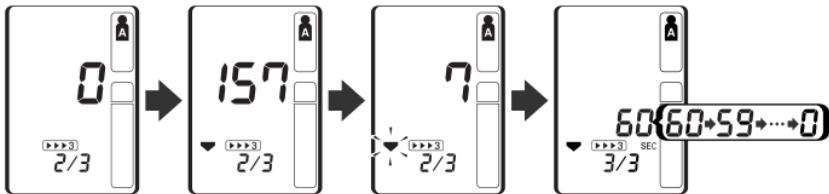

The consecutive measurements are complete. The average for three measurements appears on the display.

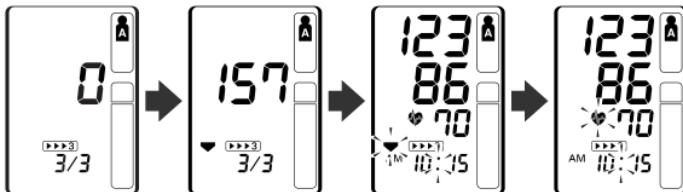

5. Press the SET button to display the blood pressure and pulse rate for the first measurement. Press the SET button again to display the next measurement.
6. Press the START/STOP button to turn the monitor off.

TAKING A MEASUREMENT

SPECIAL CONDITIONS

⚠ CAUTION

Inflating to a higher pressure than necessary may result in bruising where the cuff is applied.

If your systolic pressure is known to be more than 220 mmHg, press and hold the START/STOP button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.



- NOTE:**
- Do not apply more pressure than necessary.
 - The monitor will not inflate above 299 mmHg.

When the measurement is complete, the arm cuff completely deflates. Your blood pressure and pulse rate are displayed.

USING THE MEMORY FUNCTION

The monitor is designed to store the blood pressure and the pulse rate in the memory for two people (USER A and USER B) every time a measurement is completed.

The monitor automatically stores up to 84 sets of measurement values (blood pressure and pulse rate) for each user (A and B). When 84 sets of measurement values are stored, the oldest record is deleted to save the most recent values. The monitor also stores 8 weeks of Morning Averages and 8 weeks of Evening Averages for each user (A and B).

AVERAGING FUNCTION

The monitor calculates the average reading based on the three most recent sets of measurement values taken within 10 minutes of the most recent reading.


NOTE: If two sets of measurement values are stored in the memory for the 10 minutes period, the average is based on the two sets of measurement values. If one set of measurement values is stored, this is displayed as the average.

USING THE MEMORY FUNCTION

TO DISPLAY THE MEASUREMENT VALUES

1. Select your USER ID (A or B).
2. Press the Memory button (⌚).


The Average Symbol (▬) appears on the display when the average reading is shown.

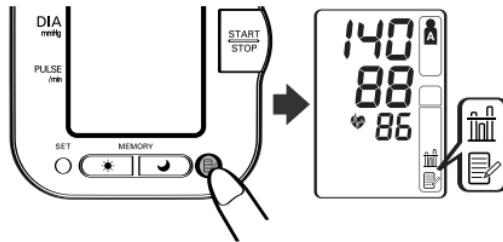

USING THE MEMORY FUNCTION

3. Press the Memory button (⌚) to display the most recent set of measurement values on the screen. The values are displayed from the most recent to the oldest.

NOTE: The date and time are alternately displayed with the measurement values.

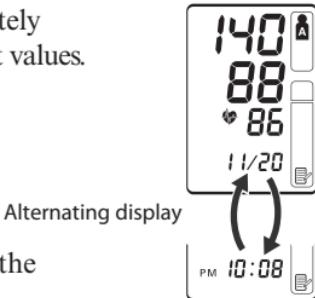


Press the Memory button to display the next set of values.

Press and hold the Memory button to display the values faster.

TruRead™ MODE

The average for the consecutive measurements appears on the display with the TruRead™ symbol (▶▶3). To display the values for the individual measurements press the SET button while the average is displayed.

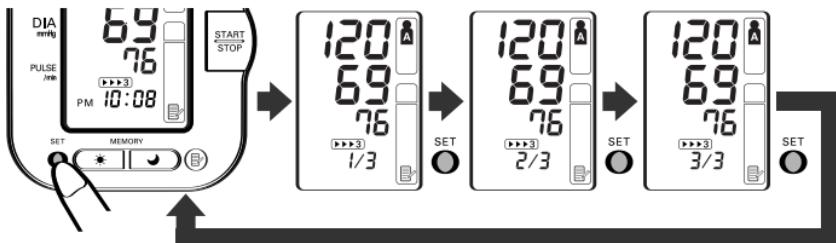

4. Press the START/STOP button to turn the power off.

USING THE MEMORY FUNCTION

MORNING AND EVENING AVERAGES

The monitor calculates and displays a weekly average for measurements taken in the morning (✿) and evening (●). The monitor stores 8 weeks of Morning Averages and 8 weeks of Evening Averages for each user (A and B).

NOTE: The week begins Sunday at 4:00 A.M.

MORNING AVERAGES

Morning averages are based on the first average reading using the TruRead™ Mode or the first reading using the Single Mode.

Measurement times must be between:

4:00 A.M. AND 9:59 A.M.

EVENING AVERAGES

Evening averages are based on the last average reading using the TruRead™ Mode or the last reading using the Single Mode.

Measurement times must be between:

7:00 P.M. AND 1:59 A.M.

USING THE MEMORY FUNCTION

TO DISPLAY MORNING AND EVENING AVERAGES


1. Select your USER ID (A or B).
2. Press the Morning Average button () or the Evening Average button ().

The average for the current week “THIS WEEK” appears on the display.



3. Continue to press the Morning Average button () or the Evening Average button () to display the previous weeks. The monitor displays “-1 WEEK” for the previous week to “-7 WEEK” for the oldest set of averages.

NOTE: If no measurement is taken in a given week, the display will appear as illustrated.



4. Press the START/STOP button to turn the monitor off.

USING THE MEMORY FUNCTION

DISPLAY COMBINATIONS

In addition to the Morning Average and Evening Average Symbols, the monitor may also display the Morning Hypertension Symbol if the morning average for that week is above the AHA guidelines. (See page 12 for details.) Depending on your measurement results, these may be displayed in the following combinations.

		Display
Morning Average	 Morning average from This Week with Morning Average Symbol	 Morning average from 7 weeks ago with Morning Average Symbol + blinking Heartbeat Symbol + Morning Hypertension Symbol
Evening Average	 Evening average from This Week with Evening Average Symbol	 Evening average from 7 weeks ago with Evening Average Symbol + blinking Heartbeat Symbol + Morning Hypertension Symbol
	Average within AHA guidelines	Average above AHA guidelines + Morning Hypertension

USING THE MEMORY FUNCTION

The Morning Hypertension Symbol (\blacktriangle) appears if the weekly average for morning measurements is above 135/85.


In this case the Morning Hypertension Symbol (\blacktriangle) is displayed when the Evening Average is displayed, regardless of the values for the Evening Average.

TO DELETE ALL VALUES STORED IN THE MEMORY

The values stored in the memory are deleted by USER ID.

You cannot partially delete values stored in the memory. All values for the user you select will be deleted.

1. Select your USER ID (A or B).
2. While holding the Memory button (⑧) and the START/STOP button simultaneously for more than 2 seconds all values will be deleted.

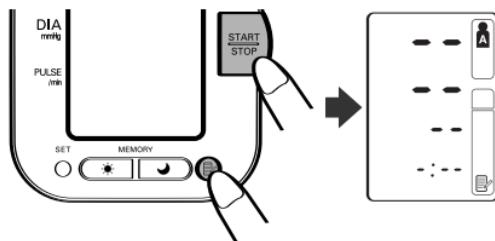

CARE AND MAINTENANCE

To keep your digital blood pressure monitor in the best condition and protect the unit from damage, follow the directions listed below:

Keep the monitor in the storage case

when not in use. Make sure the AC adapter is placed under the main unit so that it does not damage the display. Avoid kinking or sharply bending the AC Adapter cord.



Do not forcefully bend the arm cuff or air tube. Do not fold tightly.

Clean the monitor with a soft dry cloth. Do not use any abrasive or volatile cleaners. Do not attempt to clean the cuff.

⚠ CAUTION

Do not submerge the device or any of the components in water.

Do not subject the monitor to extreme hot or cold temperatures, humidity or direct sunlight.

⚠ CAUTION

Store the device and the components in a clean, safe location.

⚠ CAUTION

Do not subject the monitor to strong shocks, such as dropping the unit on the floor.

Remove the batteries if the unit will not be used for three months or longer.

Always replace all the batteries with new ones at the same time.

CARE AND MAINTENANCE

Use the unit consistent with the instruction provided in this manual.
Use only authorized parts and accessories.

⚠ CAUTION

Changes or modification not approved by Omron Healthcare
will void the user warranty.

ERROR INDICATORS AND TROUBLESHOOTING TIPS

ERROR INDICATORS

SYMBOL	CAUSE	CORRECTION
	Cuff under-inflated. Cuff not applied correctly.	Single Mode Remove the arm cuff. Read, "Taking a Measurement". Take another measurement.
	Cuff over-inflated	TruRead™ Mode The monitor will repeat the process up to 5 times.
	Monitor could not detect pulse wave.	Take another measurement and remain still until the measurement is complete.
	Air plug is not connected.	
	Batteries are worn	Replace the four batteries. Refer to "Battery Installation."

ERROR INDICATORS AND TROUBLESHOOTING TIPS

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	CAUSES AND SOLUTIONS
No power. No display appears on the unit.	Replace all four batteries with new ones. Check the battery installation for proper placement of the battery polarities.
Measurement values appear too high or too low.	Blood pressure varies constantly. Many factors including stress, time of day, and how you wrap the cuff, may affect your blood pressure. Review the sections “Before Taking a Measurement” and “Taking a Measurement.”

FCC STATEMENT

Note:

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for Canada only)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministère des communications.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARRANTY

Your HEM-780 IntelliSense® Automatic Blood Pressure Monitor, excluding the arm cuff, is warranted to be free from defects in materials and workmanship appearing within 5 years from the date of purchase, when used in accordance with the instructions provided with the monitor. The arm cuff is warranted to be free from defects in materials and workmanship appearing within one year from the date of purchase when the monitor is used in accordance with the instructions provided with the monitor. The above warranties extend only to the original retail purchaser.

We will, at our option, repair or replace without charge any monitor or arm cuff covered by the above warranties. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under the above warranties.

To obtain warranty service contact Omron Healthcare for the address of the repair location. Shipping instructions and repair information is available by calling **1-800-634-4350** or visit our website at www.omronhealthcare.com.

Enclose the Proof of Purchase. Include \$5.00 for the return shipping and handling. Include a letter, with your name, address, phone number, and description of the specific problem. Pack the product carefully to prevent damage in transit. Because of possible loss in transit, we recommend insuring the product with return receipt requested.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE WRITTEN WARRANTY ABOVE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

OMRON SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OR ANY OTHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT COSTS, EXPENSES OR DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

FOR CUSTOMER SERVICE

Visit our web site at:

www.omronhealthcare.com

Call toll free:

1-800-634-4350

SPECIFICATIONS

Model:	HEM-780
Display:	LCD Digital Display
Measurement Range:	Pressure: 0 to 299 mmHg, Pulse: 40-180/min.
Accuracy/Calibration:	Pressure: ± 3 mmHg or 2% of reading Pulse: $\pm 5\%$ of reading
Inflation:	Automatic by electric pump
Deflation:	Automatic pressure release valve
Rapid Air Release:	Automatic exhaust valve
Pressure Detection:	Capacitive pressure sensor
Measurement Method:	Oscillometric method
Pulse Wave Detection:	Capacitance type pressure sensor
Power Source:	120V 60Hz AC adapter or 4 "AA" batteries
Battery Life:	Approx. 1400 uses when used 6 times a day with 4 new alkaline batteries
Operating Temperature /Humidity:	50°F to 104°F (10°C to 40°C) /30 to 85% RH
Storage Temperature /Humidity/Air Pressure:	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) /10 to 95% RH /700 - 1060 hPa
Main Unit Weight:	Approximately 14 7/8 oz. (420 g) not including batteries
Main Unit Dimensions:	Approx. 6 3/32" (l) X 5 5/32" (w) X 3 5/16" (h) (155 mm X 131 mm X 84 mm)
Cuff Size:	Approximately 6" (w) (152 mm) Cuff tube 23 5/8" (l) (600 mm)
Cuff Circumference:	Fits arm circumferences 9" to 17" (220 mm to 420 mm)
Memory:	Up to 84 per user
Weekly Averages:	Up to 8 weeks
Contents:	Main Unit, ComFit™ Cuff, AC Adapter, Instruction Manual, 4 "AA" batteries, Storage Case and Warranty Card
UPC Code:	0 73796 78000 5

NOTE: These specifications are subject to change without notice.

NOTES

NOTES

Manufactured by OMRON HEALTHCARE

Made in China

Distributed by:

OMRON HEALTHCARE, INC.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, Illinois 60015
www.omronhealthcare.com

Copyright © 2006 Omron Healthcare, Inc.
HEM-780N3INST Rev

OMRON®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Monitor de presión sanguínea automático con banda para el brazo ComFit™

Modelo HEM-780



ESPAÑOL

TABETA DE CONTENIDOS

Antes de usar el monitor

Introducción	4
Información de seguridad	5
Operación del dispositivo	5
Riesgo de choques eléctricos	6
Cuidado y mantenimiento	7
Antes de tomar una medición	8

Instrucciones de funcionamiento

Conozca su unidad	9
Pantalla de la unidad	10
Símbolos de visualización	11
Símbolo de corazón irregular	11
Símbolo de error de movimiento	11
Símbolo de ID DE USUARIO	11
Símbolo de hipertensión matutina	12
Símbolo de corazón	13
Símbolo de valor promedio	13
Símbolo de promedio matutino	13
Símbolo de promedio nocturno	13
Instalación de la batería	14
Uso del adaptador de AC	16
Configuración de la fecha y hora	18
Colocación de la banda para el brazo	22

TABETA DE CONTENIDOS

Cómo tomar una medición	26
Uso del modo Guest	26
Selección de la ID DE USUARIO	27
Uso de la ID DE USUARIO	27
Selección del modo TruRead™	28
Uso del modo Single	30
Uso del modo TruRead™	33
Condiciones especiales	35
Uso de la función Memoria	36
Función de promedio	36
Para mostrar los valores de medición	37
Promedios matutinos y nocturnos	39
Promedios matutinos	39
Promedios nocturnos	39
Para mostrar los promedios matutinos y nocturnos	40
Combinaciones de pantalla	41
Para borrar todos los valores almacenados en la memoria ..	42
Cuidado y mantenimiento	
Cuidado y mantenimiento	43
Indicadores de error y solución de problemas	45
Declaración de la FCC	47
La Garantía	48
Especificaciones	49
Notas	50

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el monitor de presión sanguínea automático HEM-780 IntelliSense® de Omron® con banda ComFit™.

Complete lo siguiente para referencia futura.

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

Grapa aquí su recibo de compra.

Su nuevo monitor de presión sanguínea digital usa el método oscilométrico para la medición de la presión sanguínea. Esto significa que el monitor detecta el movimiento de la sangre a través de la arteria braquial y convierte el movimiento en una lectura digital. El monitor guarda los resultados de la medición para dos personas y ofrece promedios matutinos y nocturnos. TruRead™ admite tres mediciones consecutivas con intervalos programados para una lectura promedio.

El monitor de presión sanguínea HEM-780 incluye los siguientes componentes:

- Monitor
- Banda ComFit™
- Adaptador de AC
- 4 pilas "AA"
- Estuche
- Tarjeta de garantía
- Manual de instrucciones en inglés y español

El monitor de presión sanguínea automático HEM-780 IntelliSense® está destinado para uso en el hogar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para garantizar el uso correcto del producto, siempre se deben aplicar las medidas de seguridad básicas, incluyendo las advertencias y precauciones que se enumeran en este manual de instrucciones.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZAN EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES	
⚠ ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se la evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
⚠ PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se la evita, puede provocar lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente o daños al equipo u otros bienes.

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

- ⚠ Póngase en contacto con el médico para obtener información específica acerca de su presión sanguínea. El autodiagnóstico y la automedicación realizados sobre la base de los resultados de la medición pueden ser peligrosos. Siga las instrucciones del médico o el profesional médico con licencia.
- ⚠ En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua limpia. Consulte inmediatamente a un médico.
- ⚠ Lea toda la información del manual de instrucciones y cualquier otro material impreso incluido en la caja antes de usar la unidad.
- ⚠ La unidad está destinada para medir la presión sanguínea y el pulso de los pacientes adultos. Este dispositivo no debe utilizarse con bebés o con otras personas que no puedan expresar sus deseos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ⚠ Lea la sección sobre condiciones especiales (página 35) del manual de instrucciones si le consta que su presión sistólica es de más de 220 mmHg. Inflar el dispositivo a una presión más alta que la necesaria puede provocar magulladuras en el lugar donde se aplica la banda.
- ⚠ Opere el dispositivo sólo para el uso para el cual está destinado. No use el dispositivo para ningún otro propósito.
- ⚠ Respete los reglamentos locales aplicables al desechar el dispositivo, los componentes y los accesorios opcionales. La eliminación ilegal puede provocar contaminación ambiental.
- ⚠ No use teléfonos celulares cerca del dispositivo. Esto puede provocar fallas en el funcionamiento.
- ⚠ Use sólo las piezas y los accesorios Omron autorizados. Las piezas y los accesorios que no hayan sido aprobados para el uso con el dispositivo pueden causar daños en la unidad.

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

- ⚠ No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación en el tomacorrientes eléctrico con las manos mojadas.
- ⚠ No sobrecargue los tomacorrientes. Enchufe el dispositivo en un tomacorrientes con el voltaje adecuado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ⚠ No someta al monitor a golpes fuertes, como, por ejemplo, dejar caer la unidad al suelo.
- ⚠ No sumerja el dispositivo ni ninguno de sus componentes en agua.
- ⚠ Guarde el dispositivo y los componentes en un lugar limpio y seguro.
- ⚠ Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por Omron Healthcare anularán la garantía del usuario.


ANTES DE TOMAR UNA MEDICIÓN

A fin de garantizar una lectura confiable, siga estas recomendaciones:


1. Evite comer, fumar, hacer ejercicio y bañarse hasta 30 minutos antes de tomar una medición. Descanse durante al menos 15 minutos antes de tomar la medición.
2. El estrés eleva la presión sanguínea. Evite tomar mediciones en momentos de estrés.
3. Las mediciones se deben llevar a cabo en un lugar tranquilo.
4. Retire las ropas ajustadas del brazo.
5. Siéntese en una silla con los pies apoyados en el piso. Coloque el brazo sobre una mesa de modo que la banda quede al mismo nivel que el corazón.
6. Quédese quieto y no hable durante la medición.
7. Lleve un registro de su presión sanguínea y de las lecturas del pulso para que las vea su médico. Una sola medición no brinda una indicación precisa de su verdadera presión sanguínea. Necesita tomar varias mediciones y registrarlas durante un período de tiempo. Trate de medir su presión sanguínea todos los días a la misma hora para obtener mediciones coherentes.

CONOZCA SU UNIDAD


Unidad principal:

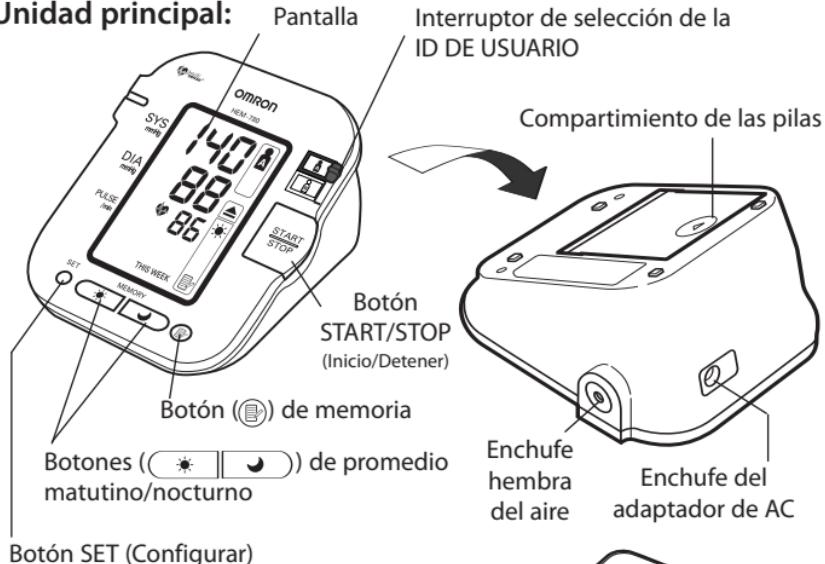

Componentes:

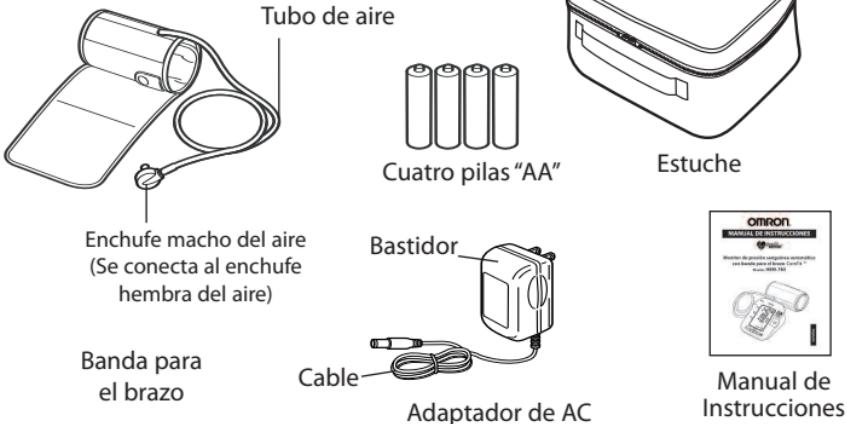

PANTALLA DE LA UNIDAD

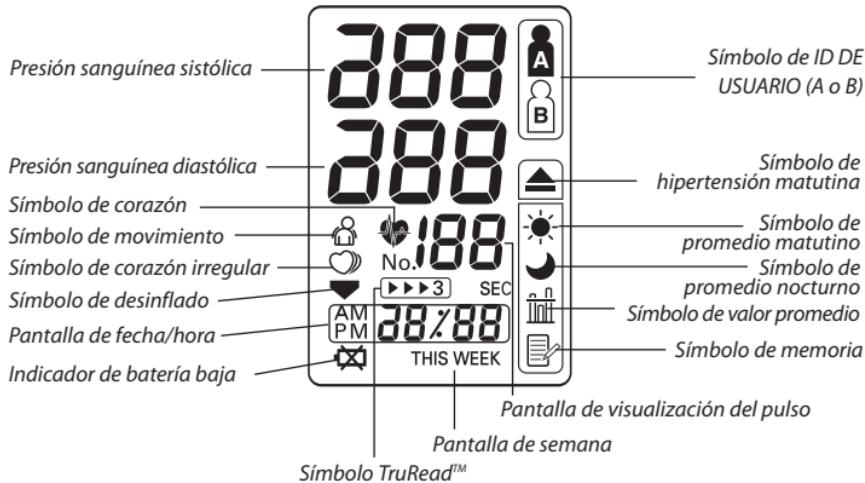


SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

SÍMBOLO DE CORAZÓN IRREGULAR (⌚)

Cuando el monitor detecta un ritmo irregular dos o más veces durante la medición, aparece en la pantalla el símbolo de corazón irregular (⌚) con los valores de medición.

El ritmo cardíaco irregular se define como un ritmo que sufre una variación de menos del 25% del ritmo promedio o más del 25% del ritmo promedio que se detecta mientras el monitor mide la presión sanguínea sistólica y diastólica.

Si se visualiza el símbolo (⌚) de corazón irregular con los resultados de su medición, le recomendamos que consulte a su médico. Siga las instrucciones del médico.

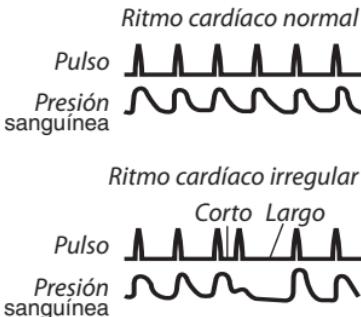

SÍMBOLO DE ERROR DE MOVIMIENTO (🏃)

El símbolo de error de movimiento aparece si usted se mueve mientras se realiza la medición. Retire la banda para el brazo y espere 2 ó 3 minutos. Tome otra medición.

SÍMBOLO DE ID DE USUARIO (👤 / 🏤)

El símbolo ID DE USUARIO indica USUARIO A o USUARIO B, según lo seleccionado por el usuario para tomar una medición o al utilizar la función de memoria. El símbolo de ID DE USUARIO no aparece en la pantalla cuando se utiliza el modo Guest para tomar una medición.

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

La Asociación Estadounidense del Corazón¹ recomienda los siguientes valores para el límite superior de la lectura normal para las lecturas de presión sanguínea tomadas en el hogar:

Pautas de la AHA para la medición doméstica del límite superior de la presión sanguínea normal	
Presión sanguínea sistólica	135 mmHg
Presión sanguínea diastólica	85 mmHg

Ésta es una pauta general dado que la presión sanguínea depende de la edad y morbilidad. La AHA recomienda un objetivo de presión sanguínea medida en el hogar más bajo para ciertos pacientes, como los pacientes diabéticos, mujeres embarazadas y pacientes con insuficiencia renal¹. El monitor no está destinado para ser utilizado como dispositivo de diagnóstico.

▲ ADVERTENCIA

Póngase en contacto con el médico para obtener información específica acerca de su presión sanguínea. El autodiagnóstico y la automedicación realizados sobre la base de los resultados de la medición pueden ser peligrosos. Siga las instrucciones del médico o el profesional médico con licencia.

Omron Healthcare le recomienda que se ponga en contacto con el médico si el SÍMBOLO DE HIPERTENSIÓN MATUTINA y/o el SÍMBOLO DE CORAZÓN aparecen en la pantalla junto con los valores de medición.

SÍMBOLO DE HIPERTENSIÓN MATUTINA (▲)

El símbolo de hipertensión matutina aparece en pantalla si la lectura promedio matutina correspondiente a una semana es superior a 135 para el valor de la presión sanguínea sistólica y/o 85 para el valor de la presión sanguínea diastólica cuando se visualizan los promedios matutinos y los promedios nocturnos en la memoria.

¹Declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón de 2004

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

SÍMBOLO DE CORAZÓN ()

CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

El símbolo de corazón parpadea en la pantalla durante la medición. El símbolo de corazón parpadea ante cada latido del corazón.

Una vez que se complete la medición, el símbolo de corazón parpadea en la pantalla junto con la presión sanguínea y el pulso si la lectura es superior a 135 para el valor de la presión sanguínea sistólica y/o 85 para el valor de la presión sanguínea diastólica.

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

El símbolo de corazón parpadea cuando la lectura de la presión sanguínea almacenada en la memoria es superior a 135 para el valor de la presión sanguínea sistólica y/o 85 para el valor de la presión sanguínea diastólica.

SÍMBOLO DE VALOR PROMEDIO ()

El símbolo de valor promedio aparece cuando se presiona el botón de memoria. La lectura del promedio más reciente aparece en la pantalla.

SÍMBOLO DE PROMEDIO MATUTINO ()

El símbolo de promedio matutino aparece al visualizar los promedios matutinos utilizando la función de memoria.


SÍMBOLO DE PROMEDIO NOCTURNO ()

El símbolo de promedio nocturno aparece al visualizar los promedios nocturnos utilizando la función de memoria.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Presione el simbolo ▼ indicador que aparece en la cubierta de las pilas y deslice la cubierta en la dirección que indica la flecha.
2. Instale 4 pilas de tamaño “AA” de modo que las polaridades + (positiva) y - (negativa) concuerden con las polaridades que se indican en el compartimiento de las pilas.

Tapa del compartimiento de las pilas

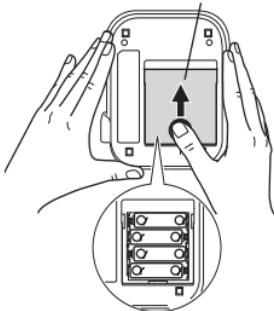

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

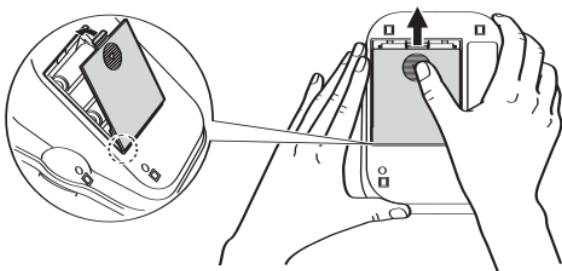

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

CAMBIO DE LAS PILAS



Indicador de batería baja

Cuando el indicador de batería baja aparece en la pantalla, apague el monitor y retire todas las pilas. Coloque cuatro pilas nuevas al mismo tiempo. Se recomienda usar pilas alcalinas de larga duración.

⚠ PRECAUCIÓN

En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua limpia. Consulte inmediatamente a un médico.

- NOTAS:**
- Apague la unidad antes de cambiar las pilas. Si las pilas se retiran mientras la unidad está encendida, la fecha y hora se reconfigurarán a la fecha y hora que se utilizó anteriormente. Sin embargo, los resultados de la medición no se borran.
 - Cuando se cambian las pilas, es posible que necesite volver a configurar la fecha y hora. Si el año parpadea en la pantalla, consulte la página 21, **Reconfiguración de la fecha y hora**.
 - Las pilas de obsequio que vienen con la unidad pueden durar menos.

⚠ PRECAUCIÓN

Respete los reglamentos locales aplicables al desechar el dispositivo, los componentes y los accesorios opcionales. La eliminación ilegal puede provocar contaminación ambiental.

USO DEL ADAPTADOR DE AC

Use sólo el adaptador de AC autorizado de Omron, Número de modelo HEM-ADPT1, con este monitor.

Le recomendamos colocar las pilas incluso si se utiliza el adaptador de AC. Si no hay ninguna pila colocada, es posible que necesite volver a configurar la fecha y hora si el adaptador de AC se desconecta. Los resultados de la medición no se borran.


⚠ PRECAUCIÓN

Use sólo las piezas y los accesorios Omron autorizados. Las piezas y los accesorios que no hayan sido aprobados para el uso con el dispositivo pueden causar daños en la unidad.

USO DEL ADAPTADOR DE AC

PARA CONECTAR EL ADAPTADOR DE AC

- ① Inserte el enchufe macho del adaptador de AC en el enchufe hembra del adaptador de AC ubicado en la parte trasera del monitor como se indica en la ilustración.

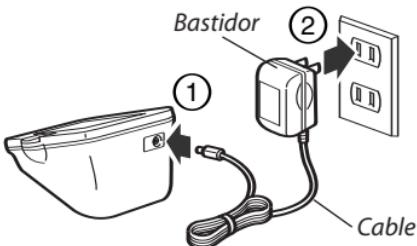

- ② Enchufe el adaptador de AC a un tomacorrientes de 120 VCA (60 ciclos).

PARA DESCONECTAR EL ADAPTADOR DE AC

- ① Sostenga el bastidor para retirar el adaptador de AC del tomacorrientes.
② Retire el enchufe del adaptador de AC del monitor.

⚠ ADVERTENCIA

No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación en el tomacorrientes eléctrico con las manos mojadas.

⚠ PRECAUCIÓN

No sobrecargue los tomacorrientes. Enchufe el dispositivo en un tomacorrientes con el voltaje adecuado.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

Configure el monitor con la fecha y hora actuales antes de tomar una medición por primera vez. Si no se configuran la fecha y la hora correctamente, es posible que los valores de medición y los valores promedio no se guarden correctamente en la memoria.


El monitor de presión sanguínea guarda automáticamente hasta 84 valores de medición individuales con las fechas y horas correspondientes. El monitor también calcula los promedios semanales para las mediciones por la mañana y por la noche. Se guardan los promedios matutinos y nocturnos correspondientes a esta semana y a las últimas siete semanas.

El monitor también puede calcular una lectura promedio basada en las tres mediciones más recientes que se tomaron dentro de un período de 10 minutos a partir de la última lectura.

- NOTAS:**
- Si sólo se guardan dos lecturas en la memoria para el período de 10 minutos, el promedio se basa en las dos lecturas.
 - Si se guarda una lectura en la memoria para el período de 10 minutos, esta lectura se muestra como el promedio.

1. PARA INICIAR LA CONFIGURACIÓN

Presione el botón de configuración (SET) para ajustar la fecha y hora.

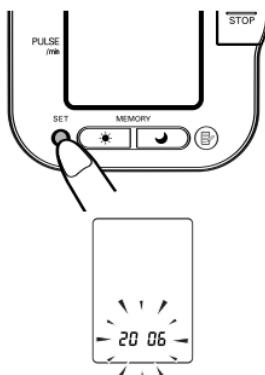

El año parpadea en la pantalla.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

2. CONFIGURACIÓN DEL AÑO

El año se puede configurar entre 2006 y 2030. Cuando la pantalla llega a 2030, vuelve a 2006.

Presione el botón Memoria (⌚) para avanzar con incrementos de un año.

Presione el botón SET (Configurar) para establecer el año actual.

El mes titila en la pantalla.



NOTA: Presione y mantenga presionado el botón Memoria (⌚) para avanzar los valores de fecha y hora más rápidamente.

3. CONFIGURACIÓN DEL MES

Presione el botón Memoria (⌚) para avanzar con incrementos de un mes.

Presione el botón SET (Configurar) para establecer el mes actual.

El día parpadea en la pantalla.



CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

4. CONFIGURACIÓN DEL DÍA

Presione el botón Memoria (⌚) para avanzar con incrementos de un día. Presione el botón SET (Configurar) para establecer el día actual.

La hora parpadea en la pantalla.



5. CONFIGURACIÓN DE LA HORA

La hora se configura con AM o PM.

Presione el botón Memoria (⌚) para avanzar con incrementos de una hora.

Presione el botón SET (Configurar) para establecer la hora actual.

Los minutos parpadean en la pantalla.



6. CONFIGURACIÓN DE LOS MINUTOS

Presione el botón Memoria (⌚) para avanzar con incrementos de un minuto.

Presione el botón SET (Configurar) para establecer los minutos actuales.

7. PARA APAGAR EL MONITOR

Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener).

NOTA: El monitor se apaga automáticamente después de que se han configurado los minutos después del cambio de las pilas.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

RECONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

Para ajustar la fecha y hora después de haberla configurado la primera vez que usa la unidad:

Comience con el monitor en la posición apagado.

1. Presione y mantenga presionado el botón SET.

El símbolo TruRead™ y la configuración actual (encendido o apagado) aparecen en la pantalla para la ID DE USUARIO seleccionada.

Para cambiar la configuración **on** (encendido) o **oFF** (apagado) presione el botón Memoria, y luego presione el botón SET.

El intervalo de tiempo parpadea en la pantalla. Presione el botón Memoria para seleccionar el intervalo de tiempo deseado, luego presione el botón SET.

El año parpadea en la pantalla.

2. Consulte la página 18, **Configuración de la fecha y hora**.

NOTA: Si necesita cambiar la fecha y hora, ajuste siempre la configuración de fecha y hora antes de tomar la medición siguiente.

COLOCACIÓN DE LA BANDA PARA EL BRAZO

⚠ PRECAUCIÓN



Lea toda la información del manual de instrucciones y cualquier otro material impreso incluido en la caja antes de usar la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN

Este dispositivo está destinado para medir la presión sanguínea y el pulso de los pacientes adultos. Este dispositivo no debe utilizarse con bebés o con otras personas que no puedan expresar sus deseos.

COLOCACIÓN DE LA BANDA EN EL BRAZO IZQUIERDO


1. Asegúrese de que el enchufe macho del aire esté correctamente insertado en la unidad principal.

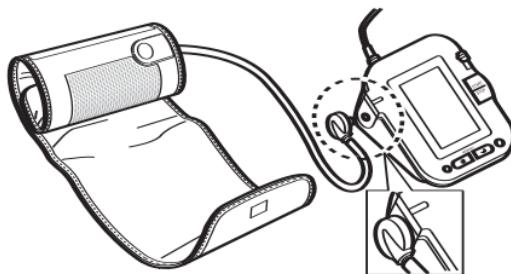

2. Retire la ropa ajustadas de la parte superior del brazo izquierdo.

COLOCACIÓN DE LA BANDA PARA EL BRAZO

3. Siéntese en una silla con los pies apoyados en el piso. Coloque el brazo en una mesa de modo que la banda quede en el mismo nivel que el corazón.

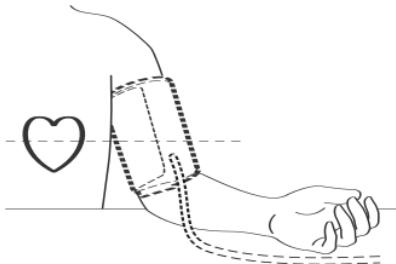

4. Sostenga firmemente el agarre de la banda con la mano derecha, colocando el pulgar en el agarre para el pulgar.




5. Coloque la palma de la mano izquierda hacia arriba.



COLOCACIÓN DE LA BANDA PARA EL BRAZO

6. Coloque la banda en la parte superior del brazo izquierdo de modo que la correas azul quede en la parte interna del brazo y alineada con el dedo medio. El tubo de aire corre hacia abajo por la parte interna del brazo. La parte inferior de la banda debe quedar aproximadamente a $1/2"$ por encima del codo.

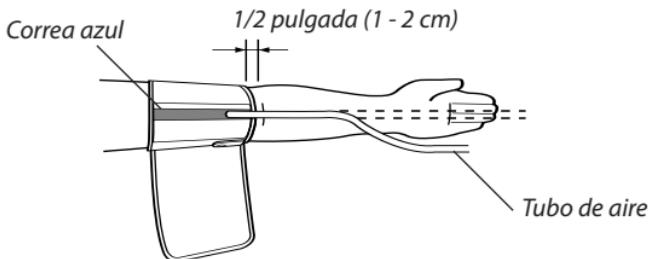

7. Coloque la banda de modo que quede bien envuelta alrededor del brazo usando la correas de tela.




COLOCACIÓN DE LA BANDA PARA EL BRAZO

COLOCACIÓN DE LA BANDA PARA EL BRAZO EN EL BRAZO DERECHO

Cuando se toma una medición en el brazo derecho, use estas instrucciones para el paso 6 de la página 24.

Coloque la banda en la parte superior del brazo derecho de modo que el agarre para el pulgar quede centrado en la parte interna del brazo. La parte inferior de la banda debe quedar aproximadamente a 1/2" por encima del codo.

Agarre para el pulgar

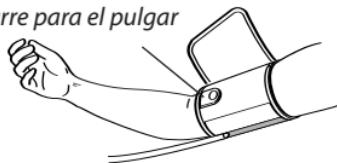

NOTA: Tenga cuidado de no apoyar el brazo sobre el tubo de aire. Esto impedirá el flujo de aire hacia la banda.

CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

El monitor ha sido diseñado para tomar mediciones y guardar los valores de medición en la memoria para dos personas, utilizando la ID DE USUARIO A e ID DE USUARIO B.

El monitor también se puede usar para tomar una sola medición para otras personas con el modo GUEST (Invitado). El símbolo de ID DE USUARIO no aparece en la pantalla cuando se utiliza el modo GUEST. Las mediciones que se toman con el modo GUEST no se guardan en la memoria.


⚠ PRECAUCIÓN

Opere el dispositivo sólo para el uso para el cual está destinado.
No use el dispositivo para ningún otro propósito.

USO DEL MODO GUEST

- Presione y mantenga presionado el botón START/STOP (Inicio/Detener).

Los símbolos A y B desaparecen de la pantalla.

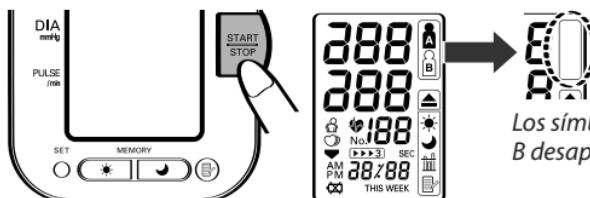

Los símbolos A y
B desaparecen

- Suelte el botón START/STOP (Inicio/Detener).

La banda comienza a inflarse automáticamente.

NOTA: Para detener el inflado, presione el botón START/STOP (Inicio/Detener). El monitor dejará de inflarse, comenzará a desinflarse y se apagará.


CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

3. El inflado se detiene y se inicia la medición. Una vez que se complete la medición, la presión sanguínea y el pulso aparecen en la pantalla.

SELECCIÓN DE LA ID DE USUARIO

Seleccione su ID DE USUARIO. Use siempre la misma ID DE USUARIO al tomar una medición. El monitor guarda los valores de medición en la memoria a través de la ID DE USUARIO seleccionada. Estos valores de medición se usan para calcular los promedios matutinos y los promedios nocturnos.

Deslice el interruptor de selección de ID DE USUARIO hacia arriba o hacia abajo para seleccionar USUARIO A o B.

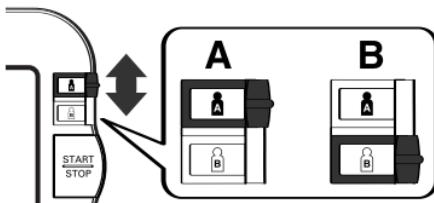

USO DE LA ID DE USUARIO

Al seleccionar una ID DE USUARIO, el monitor se puede configurar para que tome una sola medición usando el modo Single o tres mediciones consecutivas usando el modo TruRead™ cuando presiona el botón START/STOP (Inicio/Detener).


NOTA: La configuración predeterminada se establece en modo Single para tomar una medición.

El modo TruRead™ toma tres mediciones consecutivas. El monitor se infla, toma una medición y se desinfla tres veces con un breve intervalo de tiempo entre cada medición.

CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN


SELECCIÓN DEL MODO TruRead™

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).

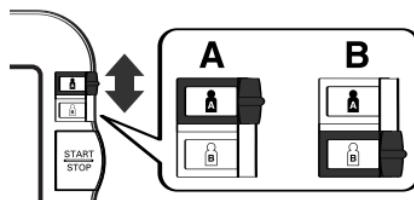


2. Presione y mantenga presionado el botón SET.

El símbolo TruRead™ y la configuración **oFF** (apagado) aparecen en la pantalla.

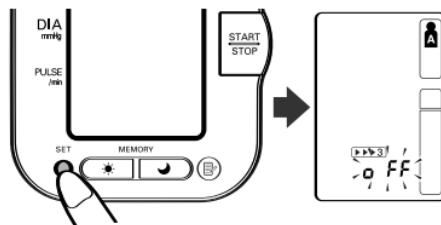


3. Presione el botón Memoria (⌚) para seleccionar **on** (encendido).

NOTA: Presione el botón Memoria para alternar entre **on** (encendido) y **oFF** (apagado).

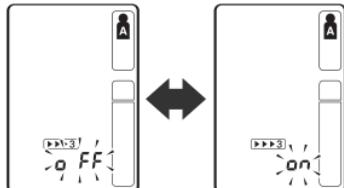

CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

- Presione el botón SET (Configurar) para confirmar el cambio.

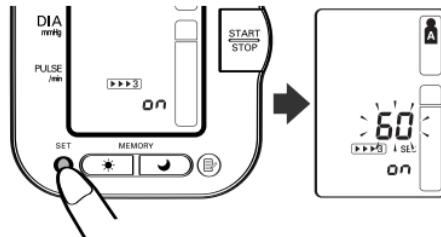

La cantidad de segundos entre cada medición aparece en pantalla.


NOTA: El valor predeterminado entre cada medición es de 60 segundos.

- Presione el botón MEMORY (Memoria) (⌚) para cambiar el intervalo de tiempo entre cada medición.

El intervalo se puede establecer en 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos o 120 segundos. Mantenga presionado el botón MEMORY (Memoria) hasta que el intervalo deseado aparezca en la pantalla.


- Presione el botón SET (Configurar) para confirmar la configuración.

El año parpadea en la pantalla.



CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

7. Si la fecha y la hora son correctas, presione el botón START/STOP (Inicio/Detener) para apagar el monitor. Para cambiar la fecha y la hora consulte la página 18, CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA.




⚠ PRECAUCIÓN

No use teléfonos celulares cerca del dispositivo. Esto puede provocar fallas en el funcionamiento.

USO DEL MODO SINGLE

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).

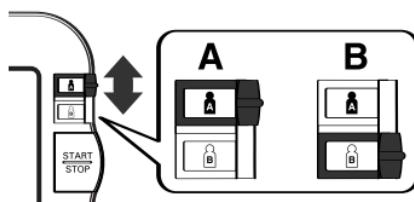


CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

2. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener).

Todos los símbolos aparecen en la pantalla. El símbolo de la ID DE USUARIO que ha seleccionado parpadea en la pantalla.

La banda comienza a inflarse automáticamente. A medida que la banda empiece a inflarse, el monitor determinará automáticamente el nivel de inflado óptimo. Este monitor detecta el pulso durante el inflado. No mueva el brazo y quedese quieto hasta que se complete el proceso de medición.

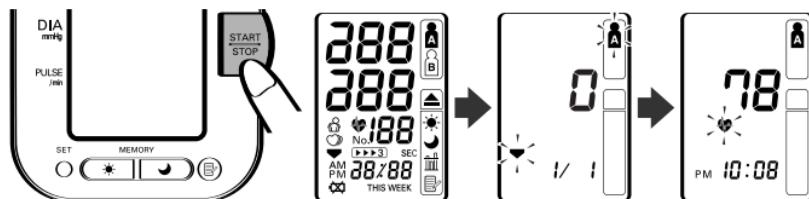

NOTA: Para detener el inflado o la medición, presione el botón START/STOP (Inicio/Detener). El monitor dejará de inflarse, comenzará a desinflarse y se apagará.

3. El inflado se detiene automáticamente y se inicia la medición.

A medida que la banda se desinfla, aparecen números en pantalla en orden decreciente. El símbolo de corazón (之心) parpadea ante cada latido del corazón.




CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

4. Una vez que se haya completado la medición, a banda se desinfla por completo. Aparecen la presión sanguínea y el pulso.



5. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener) para apagar el monitor.

NOTA: El monitor se apaga automáticamente después de cinco minutos.



CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

USO DEL MODO TruRead™

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).

2. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener).

Todos los símbolos aparecen en la pantalla. El símbolo de la ID DE USUARIO que ha seleccionado parpadea en la pantalla. La banda comienza a inflarse automáticamente.

NOTA: Para detener el inflado o la medición, presione el botón START/STOP (Inicio/Detener). El monitor dejará de inflarse, comenzará a desinflarse y se apagará.

3. El inflado se detiene automáticamente y se inicia la medición.


A medida que la banda se desinfla, aparecen números en pantalla en orden decreciente. El símbolo de corazón (之心) parpadea ante cada latido del corazón. Una vez que se haya completado la medición, la banda se desinfla por completo.

NOTA: No mueva el brazo y quédese quieto hasta que se complete el proceso de medición.

4. Verifique la marcha de las mediciones consecutivas.


NOTA: Si una medición falla, el monitor repite la toma de la medición hasta cinco veces durante el proceso de medición consecutivo.

La primera medición se ha completado, espere para iniciar la próxima medición. El intervalo de tiempo establecido entre una medición y otra aparece en la pantalla.

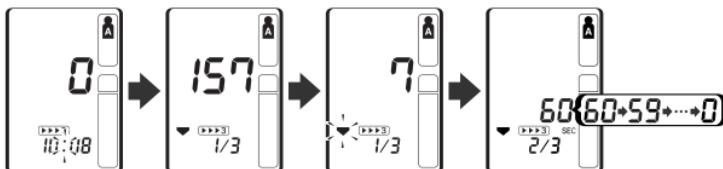


CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

La segunda medición se ha completado, espere para iniciar la próxima medición

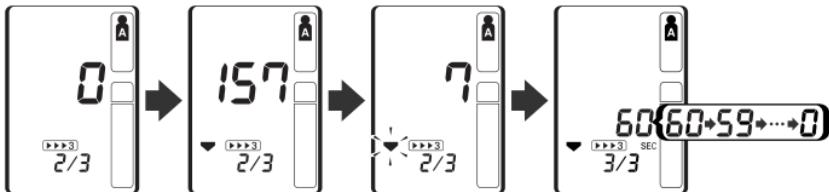

Las mediciones consecutivas se han completado. El promedio de las tres mediciones aparece en la pantalla.

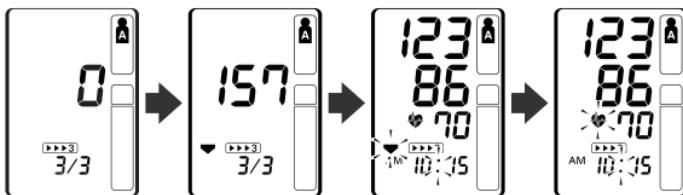

5. Presione el botón SET (Configurar) para visualizar la presión sanguínea y el pulso de la primera medición. Presione nuevamente el botón SET (Configurar) para visualizar la próxima medición.
6. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener) para apagar el monitor.

CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

CONDICIONES ESPECIALES

⚠ PRECAUCIÓN

Inflar el dispositivo a una presión más alta que la necesaria puede provocar magulladuras en el lugar donde se aplica la banda.

Si le consta que su presión sistólica es mayor que 220 mmHg, presione y mantenga presionado el botón START/STOP (Inicio/Detener) hasta que el monitor se inflé de 30 a 40 mmHg más que su presión sistólica esperada.



NOTAS: No aplique más presión de la que sea necesaria.

El monitor no se infla a más de 299 mmHg.

Una vez que se haya completado la medición, la banda se desinfla por completo. Aparecen la presión sanguínea y el pulso.

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

El monitor ha sido diseñado para guardar la presión sanguínea y el pulso en la memoria para dos personas (USUARIO A y USUARIO B) cada vez que se complete una medición.

El monitor guarda automáticamente hasta 84 conjuntos de valores de medición (presión sanguínea y pulso) para cada usuario (A y B). Una vez que se guardan 84 conjuntos de valores de medición en la memoria, el registro más antiguo se borra para guardar los valores de medición más recientes. El monitor también guarda 8 semanas de promedios matutinos y 8 semanas de promedios nocturnos para cada usuario (A y B).

FUNCIÓN DE PROMEDIO

El monitor calcula una lectura promedio basada en los valores de los tres conjuntos de mediciones más recientes que se tomaron dentro de los 10 minutos de la lectura más reciente.


NOTA: Si se guardan dos conjuntos de valores de medición en la memoria para el período de 10 minutos, el promedio se basa en los dos conjuntos de valores de medición. Si se guarda un conjunto de valores de medición, éste se visualiza como el promedio.

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

PARA MOSTRAR LOS VALORES DE MEDICIÓN

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).
2. Presione el botón Memoria (█).


El símbolo de promedio(└) aparece en la pantalla cuando se muestra la lectura promedio.

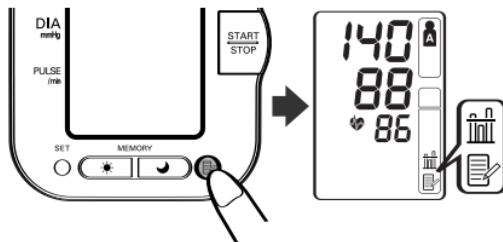

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

3. Presione el botón Memoria  para mostrar el conjunto de valores de medición más reciente en la pantalla. Los valores aparecen desde el más reciente hasta el más antiguo.

NOTA: La fecha y hora se visualizan alternativamente con los valores de medición.




Presione reiteradamente el botón Memoria para mostrar el siguiente conjunto de valores.

Presione y mantenga presionado el botón Memoria para visualizar los valores más rápidamente.

MODO TruRead™

El promedio de las tres mediciones consecutivas aparece en la pantalla junto con el símbolo TruRead™ (). Para mostrar los valores correspondientes a las mediciones individuales, presione el botón SET (Configurar) mientras se visualiza el promedio.

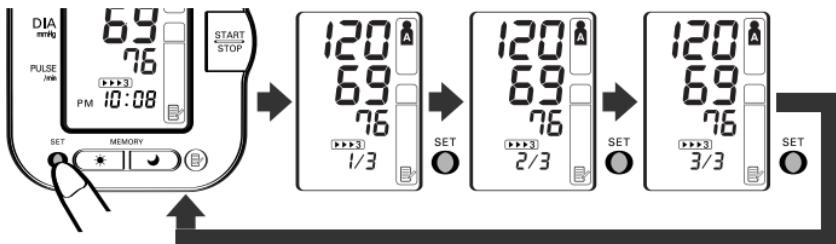

4. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener) para apagar el aparato

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

PROMEDIOS MATUTINOS Y NOCTURNOS

El monitor calcula y muestra un promedio semanal para las mediciones que se toman durante la mañana (●) y la tarde (◐). El monitor guarda 8 semanas de promedios matutinos y 8 semanas de promedios nocturnos para cada usuario (A y B).

NOTA: La semana comienza el domingo a las 4:00 AM

PROMEDIOS MATUTINOS

Los promedios matutinos se basan en la primera lectura promedio utilizando el modo TruRead™ o la primera lectura promedio utilizando el modo Single.

Los tiempos de medición deben estar entre:

4:00 A.M y 9:59 A.M.

PROMEDIOS NOCTURNOS

Los promedios nocturnos se basan en la última lectura promedio utilizando el modo TruRead™ o la última lectura promedio utilizando el modo Single.

Los tiempos de medición deben estar entre:

7:00 P.M. y 1:59 A.M.


USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

PARA MOSTRAR LOS PROMEDIOS MATUTINOS Y NOCTURNOS

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).


2. Presione el botón de promedio matutino () o el botón de promedio nocturno ().

El promedio para la semana actual “THIS WEEK” aparece en la pantalla.

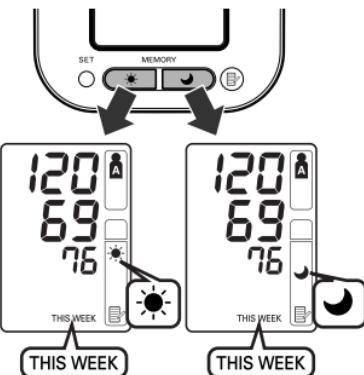

3. Siga presionando el botón de promedio matutino () o el botón de promedio nocturno () para visualizar las semanas anteriores. El monitor muestra “-1 WEEK” para la semana anterior y “-7 WEEK” para el conjunto de promedios más antiguos.

NOTA: Si no se toma ninguna medición durante una semana determinada, la pantalla se visualiza como se indica en la ilustración.



4. Presione el botón START/STOP (Inicio/Detener) para apagar el monitor.

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

COMBINACIONES DE PANTALLA

Además de los símbolos de promedio matutino y promedio nocturno, el monitor también muestra el símbolo de hipertensión matutina si el promedio matutino para esa semana es superior al de las pautas de la AHA. (Consulte la página 12 para obtener información más detallada.) Según los resultados de la medición, éstos se pueden mostrar dentro de las siguientes combinaciones.

Pantalla		
Promedio matutino	 Promedio matutino de esta semana junto con el símbolo de promedio matutino	 Promedio matutino desde hace 7 semanas con símbolo de promedio matutino + símbolo de corazón parpadeante + símbolo de hipertensión matutina
Promedio nocturno	 Promedio nocturno de esta semana junto con el símbolo de promedio nocturno	 Promedio nocturno desde hace 7 semanas con símbolo de promedio nocturno + símbolo de corazón parpadeante + símbolo de hipertensión matutina
	Promedio dentro de las pautas de la AHA	Promedio superior al de las pautas de la AHA + hipertensión matutina

USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

El símbolo de hipertensión matutina (Δ) aparece si el promedio semanal para las mediciones matutinas es superior a 135/85.


En este caso, el símbolo de hipertensión matutina (Δ) aparece en pantalla cuando se visualiza el promedio nocturno, independientemente de los valores correspondientes al promedio nocturno.

PARA BORRAR TODOS LOS VALORES QUE SE GUARDAN EN LA MEMORIA.

Los valores que se guardan en la memoria se borran por ID DE USUARIO.

No puede borrar parcialmente los valores que se guardan en la memoria. Todos los valores para el usuario seleccionado se borran.

1. Seleccione la ID DE USUARIO (A o B).
2. Al mantener presionados el botón Memoria (■) y el botón START/STOP (Inicio/Apagado) simultáneamente durante más de 2 segundos, se borran todos los valores.

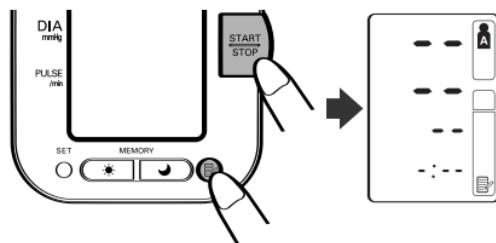

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener el monitor de presión sanguínea digital en las mejores condiciones y proteger a la unidad de modo que no se dañe, siga estas instrucciones:

Guarde el monitoren el estuche

cuando no esté en uso. Asegúrese de que el adaptador de AC esté colocado debajo de la unidad principal de modo que no dañe la pantalla. Evite enroscar o doblar en exceso el cable del adaptador de AC



No doble la banda ni el tubo de aire por la fuerza. No doble los elementos de modo que queden demasiado apretados.

Limpie el monitor con un paño seco y suave. No use limpiadores abrasivos o volátiles. No trate de limpiar la banda.

⚠ PRECAUCIÓN

No sumerja el dispositivo ni ninguno de sus componentes en agua.
No someta al monitor a temperaturas extremas altas o bajas,
humedad o luz directa del sol.

⚠ PRECAUCIÓN

Guarde el dispositivo y los componentes en un lugar limpio y seguro.

⚠ PRECAUCIÓN

No someta al monitor a golpes fuertes, como, por ejemplo, dejar caer la unidad al suelo.

Saque las pilas si no piensa utilizar la unidad durante tres meses o un período más prolongado.

Cambie siempre todas las pilas por pilas nuevas al mismo tiempo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Use la unidad de acuerdo con las instrucciones que se suministran en este manual. Use sólo las piezas y los accesorios autorizados.

⚠ PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por Omron Healthcare anularán la garantía del usuario.

INDICADORES DE ERROR Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICADORES DE ERROR

SÍMBOLO	CAUSA	CORRECCIÓN
	<p>La banda no está lo suficientemente inflada.</p> <p>La banda no está colocada correctamente.</p>	<p>Modo Single</p> <p>Retire la banda para el brazo. Consulte “Cómo tomar una medición”.</p> <p>Tome otra medición.</p>
	La banda está inflada en exceso	<p>Modo TruRead™</p> <p>El monitor repite el proceso hasta 5 veces.</p>
	<p>El monitor no pudo detectar el pulso.</p> <p>El enchufe macho del aire no está conectado.</p>	<p>Tome otra medición y quédese quieto hasta que se complete la medición.</p>
	Las pilas están gastadas	Cambie las cuatro pilas. Consulte “Colocación de las pilas”.

INDICADORES DE ERROR Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS Y SOLUCIONES
No hay alimentación eléctrica.	Cambie las cuatro pilas por pilas nuevas.
No aparece ningún símbolo en la pantalla de la unidad.	Verifique la colocación de las pilas para ver si las polaridades de las pilas están correctamente colocadas.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA:

POTENCIAL DE INTERFERENCIA DE RADIO/TELEVISIÓN (para EE.UU. solamente)

Este producto ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites fueron diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se utilice el equipo en una instalación residencial. El producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si el producto provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorrientes que esté en un circuito distinto de aquél al que se encuentra conectado
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener más información.

POTENCIAL DE INTERFERENCIA DE RADIO/TELEVISÓN (para Canadá solamente)

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio de los dispositivos digitales como se establece en la norma con respecto a equipos que causan interferencia denominada "Dispositivos digitales", ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Clase B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministère des communications.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable encargada del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

LA GARANTÍA

El monitor de presión sanguínea automático HEM-780 IntelliSense®, salvo la banda para el brazo, está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de los 5 años a partir de la fecha de compra, si se lo usa de acuerdo con las instrucciones que se suministran con el monitor. La banda para el brazo está garantizada como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de un año a partir de la fecha de compra si el monitor se usa de acuerdo con las instrucciones que se suministran con el monitor. Las garantías a las que se hace referencia anteriormente se extienden sólo al comprador minorista original.

Según la opción de la empresa, se reparará o cambiará sin cargo alguno el monitor o la banda para el brazo que estén cubiertos por las garantías a las que se hace referencia anteriormente. La reparación o el reemplazo constituye la exclusiva responsabilidad de nuestra empresa y su único recurso conforme a las garantías a las que se hace referencia anteriormente.

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con Omron Healthcare para obtener la dirección del lugar donde se efectúan las reparaciones. Las instrucciones de envío y la información sobre reparaciones pueden obtenerse llamando al **1-800-634-4350** o visitando nuestro sitio Web en www.omronhealthcare.com.

Adjunte un comprobante de compra. Incluya US\$ 5,00 para la devolución por correo. Incluya una carta con su nombre, dirección, número de teléfono y la descripción del problema específico. Empaque el producto cuidadosamente para evitar que se dañe durante el traslado. Dado que existe la posibilidad de pérdida durante el traslado, le recomendamos que asegure el producto con solicitud de acuse de recibo.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA POR ESCRITO PERTINENTE QUE APARECE ANTERIORMENTE. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

OMRON NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO COSTO, GASTO O DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO. Algunos estados no aceptan la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que las exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

PARA OBTENER SERVICIO AL CLIENTE

Visite nuestro sitio Web en:

www.omronhealthcare.com

Llame sin cargo al:

1-800-634-4350

ESPECIFICACIONES

Modelo:	HEM-780
Pantalla:	Pantalla digital LCD
Límites de medición:	Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40-180/min.
Precisión/Calibración:	Presión: ±3mmHg o 2% de lectura Pulso: ±5% de lectura
Inflado:	Automático por bomba eléctrica
Desinflado:	Válvula de liberación automática de presión
Liberación rápida de presión:	Válvula de liberación automática
Detección de presión:	Sensor de presión capacitivo
Método de medición:	Método oscilométrico
Detección del pulso:	Sensor de presión de tipo de capacitancia
Fuente de alimentación:	Adaptador de AC de 120V 60Hz o 4 pilas "AA"
Vida útil de las pilas:	Aprox. 1400 usos cuando se emplea 6 veces por día con 4 pilas alcalinas nuevas
Temperatura de funcionamiento/Humedad:	50°F a 104°F (10°C a 40°C) /30 a 85% RH
Temperatura de almacenamiento /Humedad/Presión de aire:	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C) 10 a 95% de RH / 700 - 1060 hPa
Peso de la unidad principal:	Aproximadamente 14 7/8 onzas (420 g) sin incluir las pilas
Dimensiones de la Aprox. unidad principal:	6 3/32" (largo) x 5 5/32" (ancho) x 3 5/16" (altura) (155 mm x 131 mm x 84 mm)
Tamaño de la banda:	Aproximadamente 6" (ancho) (152 mm) Tubo de la banda 23 5/8" (largo) (600 mm)
Circunferencia de la banda:	Se adapta a una circunferencia de brazo de 9" a 17" (220 mm a 420 mm)
Memoria:	Hasta 84 por usuario
Promedios semanales:	Hasta 8 semanas
Contenido:	Unidad principal, banda ComFit™, adaptador de AC, manual de instrucciones, 4 pilas "AA", estuche y tarjeta de garantía
Código UPC:	0 73796 78000 5

NOTA: Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

NOTAS

NOTAS

Fabricado por OMRON HEALTHCARE

Hecho en China

Distribuido por:

OMRON HEALTHCARE, INC.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, Illinois 60015
www.omronhealthcare.com

Copyright © 2006 Omron Healthcare, Inc.
HEM-780N3INST Rev

1658806-1A