RESMED

S9 AutoSet™ & S9 Elite™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

Welcome Guide

Português

S9™ Series
More. Comfort.

S9™
Series
More. Comfort.

Boas-vindas

Obrigado por ter escolhido o S9 AutoSet ou S9 Elite. Antes de utilizar estes dispositivos, leia os Manuais Informativo e de Boas-vindas na íntegra.

Entrada de corrente CC

Porta de Módulo/Adaptador

Filtro de ar

Ranhura para cartão SD

Saída de ar

Descrição do S9

O sistema S9 inclui os seguintes elementos:

• Dispositivo S9 • Tubagem de ar SlimLine • Unidade de alimentação de 90 ou 30 W • Bolsa de transporte do S9 • Cartão SD • Capa de protecção do cartão SD do S9.

Os componentes opcionais incluem:

• Humidificador aquecido H5i • Cuba de água H5i • Tubagem de ar standard • Tubagem aquecida ClimateLine • Tubagem aquecida ClimateLine^{MAX} • Unidade de alimentação de 90 W • Unidade de alimentação de 30 W (não suporta o H5i) • Unidade de bateria Power Station II • Transformador CC/CC de 24 V/90 W.

Sugestões em viagem

Durante deslocações apenas com o seu S9:

- certifique-se de que coloca a tubagem de ar SlimLine ou standard, na medida em que a tubagem de ar aquecido ClimateLine ou ClimateLine^{MAX} não deve ser ligada directamente ao dispositivo S9;
- certifique-se de que adquire e viaja com o cabo eléctrico aprovado para a região onde pretende utilizar o dispositivo S9.

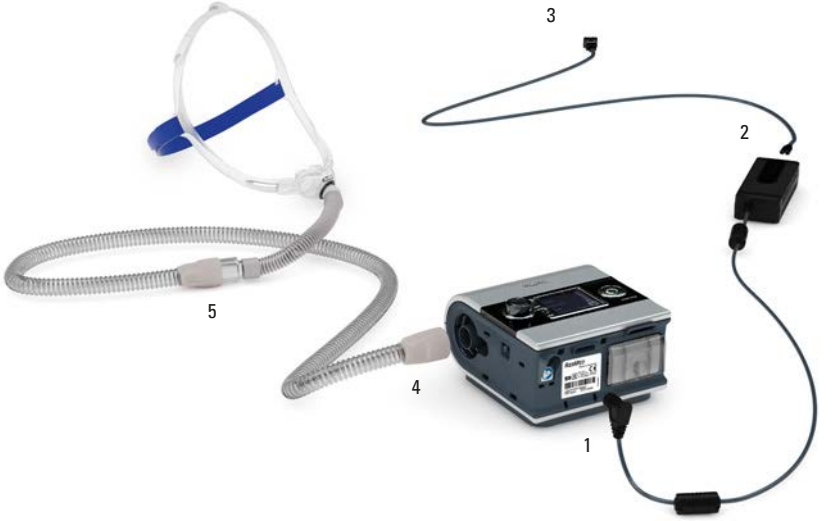

Configuração

1. Ligue a ficha CC da unidade de alimentação à parte de trás do S9.
2. Ligue o cabo eléctrico à unidade de alimentação.
3. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico à tomada.
4. Ligue, de forma segura, uma das extremidades da tubagem de ar à saída de ar.
5. Ligue a máscara montada à extremidade livre da tubagem de ar.

Notas:

- *Para obter mais informações sobre a montagem da máscara, consulte o respectivo manual do utilizador.*
- *As máscaras recomendadas estão disponíveis em www.resmed.com na página relativa aos Produtos na área de Serviço e assistência.*

Informações básicas sobre o S9

*Os menus Info e Configuração estão desactivados se o S9 Essentials tiver sido activado pelo médico.

Ajustar o tempo de rampa

Concebido de forma a tornar o início do tratamento mais confortável, o tempo de rampa é o período durante o qual a pressão aumenta de uma pressão inicial baixa até à pressão de tratamento. Para ajustar o tempo de rampa:

1. No ecrã Início, rode até o ecrã RAMPA ser apresentado a azul.

2. Prima . A selecção aparece destacada a cor-de-laranja.

3. Rode até ser apresentado o tempo de rampa pretendido.

4. Prima para confirmar a escolha.

Utilização do ajuste da máscara

Pode utilizar a função de ajuste da máscara para o ajudar a colocar a máscara adequadamente. Esta função fornece pressão de tratamento durante um período de três minutos antes do início do tratamento, para que possa verificar e ajustar a colocação da máscara de modo a minimizar as fugas.

1. Coloque a máscara tal como é descrito no respectivo manual do utilizador.
2. No ecrã Início, prima continuamente durante três segundos. É apresentado um dos seguintes ecrãs AJUSTE MÁSC:



3. Se necessário, ajuste a máscara, a almofada da máscara e o arnês até obter um ajuste Bom. Após três minutos, a pressão retorna à pressão programada e o tratamento é iniciado. Pode terminar o ajuste da máscara em qualquer momento premindo .

S9 Essentials

O S9 Essentials foi desenvolvido para lhe facilitar a interacção com o dispositivo e a navegação nos menus. Se o médico o activar, o S9 Essentials desactiva as funcionalidades Info e Configuração para que possa simplesmente iniciar e interromper a terapêutica e ajustar a rampa, a humidificação e o Climate Control.

Selecção do tipo de máscara*

Para seleccionar o tipo de máscara:



1. Prima . É apresentado o ecrã CONFIGS.



2. Rode até a opção Máscara ser apresentada a azul.



3. Prima .
A selecção aparece destacada a cor-de-laranja.

4. Rode até aparecer o parâmetro de máscara pretendido.

5. Prima para confirmar a escolha.



6. Prima para voltar ao ecrã Início.

**A selecção do tipo de máscara não é possível se o S9 Essentials tiver sido activada pelo médico.*

Introdução

1. Certifique-se de que a unidade se encontra ligada.
2. Ajuste o tempo de rampa, se necessário.
3. Coloque a máscara tal como é descrito nas respectivas instruções do utilizador.
4. Para iniciar a terapia, basta respirar para dentro da máscara e/ou premir .
5. Deite-se e disponha a tubagem de ar de modo que esta possa mover-se no caso de se voltar enquanto dorme.
6. Para parar o tratamento em qualquer altura, retire a máscara e/ou prima .

Notas:

- *Se o seu médico tiver activado a função SmartStart, o dispositivo começará a funcionar automaticamente quando respirar para dentro da máscara e parará automaticamente quando retirar a máscara.*
- *Uma vez iniciada a terapia, é apresentado o ecrã de tratamento.*
- *Se ocorrer um corte da alimentação durante o tratamento, o dispositivo reiniciará a terapêutica automaticamente quando a energia for restaurada.*

Limpeza e manutenção

Consulte os manuais do utilizador da máscara e do humidificador para obter instruções pormenorizadas relativas aos cuidados a prestar a estes dispositivos.

Diariamente

Remova a tubagem de ar puxando a manga com os dedos colocados no local adequado. Pendure-a num local limpo e seco até à próxima utilização.

Notas:

- *Não pendure a tubagem de ar exposta à luz directa do sol, uma vez que pode endurecer gradualmente, acabando por quebrar.*
- *Não lave a tubagem de ar numa máquina de lavar roupa ou louça.*

Semanalmente

1. Retire a tubagem de ar do dispositivo S9 e da máscara.
2. Lave a tubagem de ar em água morna e detergente suave.
3. Enxagúe bem e pendure a secar.
4. Antes da utilização seguinte, volte a ligar a tubagem de ar à saída de ar e à máscara.

Mensalmente

1. Limpe o exterior do S9 com um pano húmido e detergente suave.
2. Verifique se o filtro de ar está perfurado ou obstruído por sujidade ou poeiras. Se necessário, substitua o filtro de ar.

Substituição do filtro de ar

Substitua o filtro de ar a cada seis meses (ou com maior frequência, se necessário).

1. Retire a tampa do filtro de ar que se encontra na parte de trás do dispositivo S9.
2. Remova e deite fora o filtro de ar usado.
3. Insira um novo filtro de ar ResMed certificando-se de que está bem encostado à tampa do filtro de ar.
4. Volte a colocar a tampa do filtro de ar.

Notas:

- *Certifique-se de que o filtro de ar e a tampa do filtro de ar estejam sempre instalados.*
- *Não lave o filtro de ar. O filtro de ar não é lavável nem reutilizável.*

Cartão SD

Foi fornecido um cartão SD para a recolha de dados de terapia do dispositivo S9 e para proporcionar actualizações de parâmetros realizadas pelo seu médico. Quando receber indicações para tal, desligue o dispositivo S9 da tomada, retire o cartão SD, introduza-o na capa de protecção e envie-o ao seu médico.

Remoção do cartão

1. Empurre o cartão SD para soltá-lo.
2. Remova o cartão.
3. Insira o cartão na capa de protecção.
4. Devolva a capa de protecção ao seu médico conforme as instruções.

Para obter mais informações sobre como retirar e introduzir o cartão, consulte a Capa de Protecção do Cartão SD S9 fornecido com o dispositivo. Guarde a Capa de Protecção do Cartão SD S9 para utilização futura.

1.

2.

3.

4.

Notas:

- *Para obter informações sobre detecção e resolução de problemas, consulte o Manual Informativo.*
- *Para obter mais informações sobre o produto, consulte www.resmed.com.*

S9™
Series
More. Comfort.

368868/3 2013-04
S9 Series
AutoSet & Elite
WELCOME
EUR 1/3

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, AutoSet, S9 Elite, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd. S9, AutoSet, H5i, ClimateLine and SlimeLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office.
© 2013 ResMed Ltd.

CE 0123