


# HI 736

## Fósforo Gama Ultra Baixa

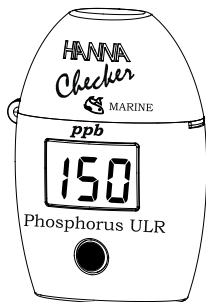

Estimado Cliente,

Obrigado por ter escolhido um produto Hanna Instruments. Antes de utilizar o instrumento, por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em enviar-nos um e-mail para [assistencia@hannacom.pt](mailto:assistencia@hannacom.pt)

### Exame preliminar:

Por favor examine este produto cuidadosamente. Assegure-se que o instrumento não se encontra danificado. Se ocorrer qualquer dano durante o transporte, por favor notifique o seu revendedor.

Cada medidor HI 736 é fornecido completo com:

- Duas cuvetes de amostragem e tampas
- Sei reagentes em pó para Fósforo
- 1 pilha de 1.5V AAA
- Manual de Instruções




**Para mais detalhes sobre peças sobressalentes e acessórios veja "Acessórios".**

### Especificações técnicas:

<b>Gama</b>	0 a 200 ppb
<b>Resolução</b>	1 ppb
<b>Precisão</b>	±5 ppb ±5% da leitura @ 25 °C / 77 °F
<b>Fonte de Luz</b>	Diódo Emissor de Luz @ 525 nm
<b>Detector de Luz</b>	Foto-célula de Silício
<b>Método</b>	Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição, método Ácido Ascórbico. A reacção entre o fósforo reactivo e o reagente provoca uma coloração azul na amostra.
<b>Ambiente</b>	0 a 50 °C (32 a 122 °F); máx 95% HR não condensável
<b>Tipo de Pilha</b>	1 x 1.5V AAA
<b>Desligar automático</b>	Após 3 minutos de inactividade e 2 minutos após a leitura
<b>Dimensões</b>	81.5 x 61 x 37.5 mm
<b>Peso</b>	64 g

### Descrição funcional:



1. Tapa de cuvette.
2. Cuvete com tampa.
3. Suporte de cuvette.
4. Mostrador (LCD).
5. Botão

### Erros e avisos:



**Luz elevada:** há demasiada luz para efectuar uma medição. Por favor verifique a preparação da cuvette zero.



**Luz fraca:** não há luz suficiente para efectuar uma medição. Por favor verifique a preparação da cuvette zero.



**Cuvetes invertidas:** a cuvette de amostra e a de zero estão invertidas.



**Sob Gama:** Um "0" a intermitente indica que a amostra absorve menos luz que a referência zero. Verifique o procedimento e assegure-se que utiliza a mesma cuvette para a referência (zero) e medição.



**Acima da Gama:** Um valor a intermitente do valor máximo de concentração indica uma condição acima da gama. Dilua a amostra e volte a efectuar o teste.



**Pilha fraca:** A pilha deve ser substituída a breve.



**Pilha morta:** Isto indica que a pilha está morta e deve ser substituída. Uma vez visualizada esta indicação, o funcionamento normal do instrumento será interrompido. Troque a pilha e reinicie o instrumento.




## Procedimento de medição:

Ligue o medidor pressionando o botão. Todos os segmentos serão indicados. Quando o mostrador indicar "Add", "C.1" com "Press" a intermitente, o medidor está pronto.




Encha a cuvete com 10 mL de amostra não reagida e coloque a tampa. Coloque a cuvete no medidor e feche a tampa do medidor.




Pressione o botão. Quando o mostrador indicar "Add", "C.2" com "Press" a intermitente, o medidor está a zero.




Remova a cuvete do medidor e desaperte a tampa. Adicione conteúdo de uma embalagem de reagente HI 736-25. Coloque a tampa e agite cuidadosamente durante 2 minutos até o reagente estar completamente dissolvido. Coloque a cuvete novamente no instrumento.



Pressione e mantenha o botão até que o temporizador seja indicado no mostrador (o mostrador indicará a contagem decrescente antes da medição) ou, em alternativa, aguarde 3 minutos e pressione o botão.



O instrumento indica directamente o conteúdo de fósforo em ppb. O medidor desliga-se automaticamente após 2 minutos



## Conselhos para uma medição precisa

- É importante que a amostra não contenha nenhum resíduo.
- Quando a cuvete é colocada na célula de medição, esta deve estar seca exteriormente, e completamente livre de impressões digitais, óleo e sujidade. Limpe-a bem com HI 731318 ou um tecido livre de pêlos antes de a inserir.
- Agitar a cuvete pode gerar bolhas, originando leituras mais altas. Para obter medições precisas, remova as bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete.
- Não deixe a amostra reagida repousar muito depois de adicionar o reagente, a precisão será afectada.
- Após a leitura é importante deitar imediatamente fora a amostra, caso contrário o vidro pode ficar permanentemente manchado.


## Gestão de pilha

Para economizar a pilha, o instrumento desliga-se após 10 minutos sem utilização. Uma pilha nova dura um mínimo de 5000 medições. Quando a pilha está morta, o instrumento indicará "bAd" e depois "bAt" durante 1 segundo e depois desliga-se.

Para reiniciar o instrumento, a pilha deve ser substituída por uma nova.

Para substituir a pilha do instrumento:

- Desligue o instrumento mantendo o botão pressionado até que o medidor se desligue.
- Vire o instrumento com o fundo para cima e remova a tampa do compartimento da pilha usando uma chave-de-parafusos.



- Remova a pilha do seu local e substitua-a por uma nova, inserindo a extremidade negativa primeiro
- Insira a tampa da pilha e volte a colocar o parafuso com uma chave-de-parafusos.

## Acessórios:

### CONJUNTO DE REAGENTES

HI 736-25 Conjunto de reagentes para 25 testes de Fósforo Gama Ultra Baixa

### OUTROS ACESSÓRIOS

HI 736-11 Estajo de Padrões Certificados de Fósforo GUB

HI 731318 Tecido para a limpeza de cuvetes (4 un)

HI 731321 Cuvetes em vidro (4 un)

HI 731225 Tampa para cuvetes para checker HC (5 un)

HI 731353 Tampa vedante de cuvete para checker HC (4 un.)

HI 740028 Pilhas de 1.5V AAA (4 un)

HI 93703-50 Solução de limpeza para cuvetes (230 mL)

### Recomendações aos Utilizadores

Antes de utilizar este instrumento, certifique-se da sua adequação à sua aplicação específica e ao meio ambiente em que o vai utilizar.

A utilização deste instrumento pode originar interferências inaceitáveis em outros equipamentos eletrónicos, requerendo que o utilizador efectue todos os passos necessários para a correcção dessas interferências.

Qualquer alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador, pode resultar na degradação do seu desempenho EMC.

Para evitar danos ou queimaduras, não coloque o instrumento no forno micro-ondas. Para a sua segurança e a do instrumento, não o utilize nem armazene em ambientes perigosos.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

**Para informações adicionais, contacte o seu revendedor ou o Serviço de Apoio ao Cliente Hanna. Visite o nosso website:**

[www.hannainstruments.com.pt](http://www.hannainstruments.com.pt)

**HANNA**<sup>®</sup>  
instruments